

LICITACIÓN PÚBLICA No. SSSLP-LP-N031-2021

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
"SERVICIOS INTEGRALES"**

SERVICIO INTEGRAL DE BOMBAS Y PERCUSORES DE INFUSIÓN

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2021, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, EN ESTA CIUDAD, LAS PERSONAS MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SSSLP-LP-N031-2021.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE LOS SERVICIOS DE SALUD NO CUENTAN CON EL EQUIPO Y LA TECNOLOGÍA PARA SOLVENTAR LAS DISPOSICIONES MANIFESTADAS EN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRORROGAS DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, POR LO CUAL SE PROCEDE A LA GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO CON LOS MEDIOS QUE SE TIENE AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL C. LIC. ADOLFO MARTÍNEZ LÓPEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, FUNCIONARIO PÚBLICO FACULTADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS; POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LA C. C.P. GUADALUPE ALONSO HERNÁNDEZ, POR EL ÁREA ASESORA LA C. LIC. SCARLET NANCY SÁNCHEZ MUÑOZ, ASESOR JURÍDICO; Y POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL C. MTRO. ULICES ABNER GARCÍA HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO; SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS PARTICIPANTES INSCRITOS:


1. HOSPIMEDICAL S.A. DE C.V.
2. EQUIPOS QUIRÚRGICOS POTOSINOS S.A. DE C.V.

EN ESTE MOMENTO SE SOLICITA AL ASISTENTE LA PRESENTACIÓN DEL RECIBO DE COMPRA DE BASES, CON EL OBJETO DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA PARTICIPAR EN ESTE EVENTO.

ACTO SEGUIDO, A SOLICITUD DEL ÁREA TÉCNICA Y CON PROPÓSITO DE DAR CABAL RESPUESTA A CADA UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS REALIZADOS POR LOS PARTICIPANTES LA CONVOCANTE APERTURA RECESO EN LA PRESENTE JUNTA, REANUDANDO EL DÍA JUEVES 15 DE JULIO A LAS 12:00 HRS.

LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO A SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, FIRMÁNDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN A CONTINUACIÓN. DÁNDOSE POR TERMINADO EL ACTO A LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2021.


POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

C. LIC. ADOLFO MARTÍNEZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


POR EL ÁREA CONTABLE

C. C.P. GUADALUPE ALONSO HERNÁNDEZ
POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD


POR EL ÁREA ASESORA

C. LIC. SCARLET NANCY SÁNCHEZ MUÑOZ
ASESOR JURÍDICO

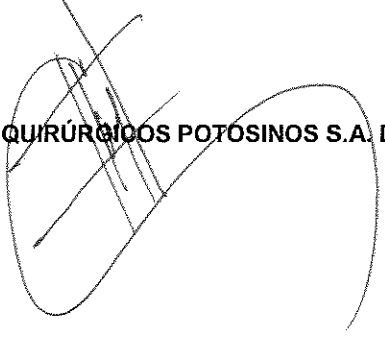
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


C. MTRO. ULICES ABNER GARCÍA HERNÁNDEZ.
AUDITOR INTERNO

PARTICIPANTES

HOSPIMEDICAL S.A. DE C.V.


C. SUSANA JIMÉNEZ


EQUIPOS QUIRÚRGICOS POTOSINOS S.A. DE C.V.

C. JORGE ARTURO AZUA RODRÍGUEZ



PROSPEREMOS JUNTOS

Gobierno del Estado 2015-2021

**SERVICIOS
DE SALUD**

LICITACIÓN PÚBLICA No. SSSLP-LP-N031-2021

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
"SERVICIOS INTEGRALES"
SERVICIO INTEGRAL DE BOMBAS Y PERCUSORES DE INFUSIÓN**

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2021, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, EN ESTA CIUDAD, LAS PERSONAS MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SSSLP-LP-N031-2021.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE LOS SERVICIOS DE SALUD NO CUENTAN CON EL EQUIPO Y LA TECNOLOGÍA PARA SOLVENTAR LAS DISPOSICIONES MANIFESTADAS EN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRORROGAS DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, POR LO CUAL SE PROCEDE A LA GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO CON LOS MEDIOS QUE SE TIENE AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL C. LIC. ADOLFO MARTÍNEZ LÓPEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, FUNCIONARIO PÚBLICO FACULTADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS; POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LA C. C.P. CELENE MORENO JUÁREZ, POR EL ÁREA ASESORA LA C. LIC. SCARLET NANCY SÁNCHEZ MUÑOZ, ASESOR JURÍDICO; Y POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL C. MTRO. ULICES ABNER GARCÍA HERNÁNDEZ, AUDITOR INTERNO; SE PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS PARTICIPANTES INSCRITOS:

1. HOSPIMEDICAL S.A. DE C.V.
2. EQUIPOS QUIRÚRGICOS POTOSINOS S.A. DE C.V.

EN ESTE MOMENTO SE SOLICITA AL ASISTENTE LA PRESENTACIÓN DEL RECIBO DE COMPRA DE BASES, CON EL OBJETO DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA PARTICIPAR EN ESTE EVENTO.

SE REANUDA EL ACTO Y ENSEGUIDA SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN ANTES CITADA, EN EL ORDEN SIGUIENTE:

POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

1. LA CONVOCANTE ACLARA QUE AQUELLOS PROVEEDORES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE ATRASO EN LA ENTREGA DE INSUMOS DERIVADOS DE OTROS PROCESOS, SEAN DE LICITACIÓN, INVITACIÓN Y/O COMPRA DIRECTA, **NO SERÁ RECIBIDA SU PROPUESTA EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**, POR LO QUE SE LES RECOMIENDA REGULARIZAR EN FORMA INMEDIATA SU SITUACIÓN A EFECTO QUE PUEDAN PARTICIPAR LIBREMENTE EN ESTE PROCESO.

2. DE CONFORMIDAD CON LOS PUNTOS 7 Y 8 DE LA SECCIÓN III DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN (LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA), NO SE AUTORIZARAN LOS BIENES ADJUDICADOS SI NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO CON LO ESPECIFICADO EN LOS PUNTOS 1 Y 2 DE LA MISMA SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, RELATIVO A LA FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZA.
3. REFERENTE AL PUNTO 2 DE LA SECCIÓN III DE LAS CONVOCATORIA DE LICITACIÓN LOS LICITANTES QUE RESULTEN CON ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DEBERÁN DE PRESENTAR APARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE PUNTO, COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DEL 30% CON IVA INCLUIDO DEL TOTAL DE SERVICIOS ADJUDICADOS DEBIDAMENTE SELLADA POR EL ÁREA JURÍDICA Y LA PENALIZACIÓN SERA DEL 10% .
4. LA CONVOCANTE ACLARA QUE TODA FACTURA DEBE CONTENER DENTRO DEL CUERPO DE LA MISMA, EL MÉTODO DE PAGO: CONCEPTO 03 TRANSFERENCIA DE FONDOS Y DEBERÁ ANEXAR LOS SIGUIENTES DATOS:
 - RAZÓN SOCIAL
 - REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)
 - NOMBRE DEL BANCO
 - SUCURSAL Y/O PLAZA
 - CLABE INTERBANCARIA
 - CUENTA BANCARIA
 - NOMBRE DE UN CONTACTO
 - CORREO ELECTRÓNICO DE UN CONTACTO
5. LA CONVOCANTE ACLARA QUE ADEMÁS DE PRESENTAR LO SOLICITADO EN LA SECCIÓN III, PUNTO 4 FACTURACIÓN, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR EN 5 TANTOS LA HOJA DE VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL QUE EMITE EL SAT EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>.
6. LA CONVOCANTE ACLARA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL REGISTRO AL SISTEMA DE PADRÓN ÚNICO DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES O LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ DEL PERIODO 2021, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE PARA FUTUROS EVENTOS ÚNICAMENTE TENDRÁ VALIDEZ EL EXPEDIDO POR OFICIALÍA MAYOR.

EN ESTE MOMENTO Y DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 3.1 QUINTO PÁRRAFO DE LA SECCIÓN I DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN SE DARA RESPUESTA A TODAS Y A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SE HAYAN RECIBIDO PREVIAMENTE.

PREGUNTAS DEL LICITANTE: HOSPI-MEDICAL, S.A de C.V

PREGUNTA 1

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 A,

CONSUMIBLES :

DICE: EQ. PARA BOMBAS STD Y EL EQ. DE BAJO PURGADO (AQUÍ SE SUMAN AMBAS CANTIDADES) EL CODIGO VLST02 ES EL MISMO PARA AMBOS

DESCRIPCION PROPUESTA

EQUIPO (LÍNEA) DE INFUSIÓN ESTANDAR LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 15 MICRAS Y PUERTO DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEÓ TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y" LIBRE DE LATEX QUE NO REQUIERE AGUJAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO

GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ML

SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR

CONSUMIBLES :

EQ. PARA BOMBAS STD Y EL EQ. DE BAJO PURGADO (AQUÍ SE SUMAN AMBAS CANTIDADES) CON EL CODIGO 14001 ES EL MISMO PARA AMBOS

DESCRIPCION PROPUESTA :

EQUIPO DE INFUSIÓN ESTANDAR LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 15 MICRAS Y PUERTO DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON TECNOLOGÍA DE CASSETTE CUENTA CON CANAL SECUNDARIO QUE PERMITE AL USUARIO REALIZAR UNA O DOS INFUSIONES SIMULTÁNEAS O ALTERNAS Y SACAR EL AIRE DE LA LÍNEA A TRAVÉS DE RETROPURGADO SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR AL PACIENTE, CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y" LIBRE DE LATEX QUE NO REQUIERE AGUJAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 272 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 19 ML. SON COMPATIBLES CON BOMBA DE INFUSION PLUM 360

R: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO

PREGUNTA 2

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 A,

CONSUMIBLES :

DICE: EQ. DE TRANSFUSION CODIGO VLTR00

DESCRIPCION PROPUESTA

EQUIPO (LÍNEA) DE TRANSFUSIÓN LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 200 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA SIN ENTRADA DE AIRE FILTRADO; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 200 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ML

SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR

CONSUMIBLES :

EQ. DE TRANSFUSION CODIGO 14211

DESCRIPCION PROPUESTA :

EQUIPO DE TRANSFUSIÓN LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 200 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA SIN ENTRADA DE AIRE FILTRADO; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 200 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON TECNOLOGÍA DE CASSETTE CUENTA CON CANAL SECUNDARIO QUE PERMITE AL USUARIO REALIZAR UNA O DOS INFUSIONES SIMULTÁNEAS O ALTERNAS Y SACAR EL AIRE DE LA LÍNEA A TRAVÉS DE RETROPURGADO SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR AL PACIENTE; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 279 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~52ML SON COMPATIBLES CON BOMBA DE INFUSION PLUM 360

R: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO

PREGUNTA 3

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 A,

CONSUMIBLES :

DICE: EQ. VOL. MEDIDOS CODIGO VLPA92

DESCRIPCION PROPUESTA

EQUIPO (LÍNEA) DE INFUSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS CON BURETA GRADUADA DE 150 ML, PORTAL DE INYECCIÓN Y FILTRO DE 15 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CLIP TIPO ROBSON; BURETA GRADUADA DE 150 ML CON ENTRADA DE AIRE PROTEGIDA POR UN FILTRO ANTIBACTERIAL Y TAPÓN, PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y" LIBRE DE LÁTEX QUE NO REQUIERE AGUJA ENSAMBLADO EN LA LÍNEA; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 300 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ML (SIN TOMAR EN CUENTA EL VOLUMEN DE LA BURETA)

SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR

CONSUMIBLES :

EQ. VOL. MEDIDOS CODIGO 14004

DESCRIPCION PROPUESTA

EQUIPO DE INFUSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS CON BURETA GRADUADA DE 150 ML, PORTAL DE INYECCIÓN Y FILTRO DE 15 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CLIP TIPO ROBSON; BURETA GRADUADA DE 150 ML CON ENTRADA DE AIRE PROTEGIDA POR UN FILTRO ANTIBACTERIAL Y TAPÓN, PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; ; MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON TECNOLOGÍA DE CASSETTE CUENTA CON CANAL SECUNDARIO QUE PERMITE AL USUARIO REALIZAR UNA O DOS INFUSIONES SIMULTÁNEAS O ALTERNAS Y SACAR EL AIRE DE LA LÍNEA A TRAVÉS DE RETROPURGADO SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR AL PACIENTE; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y" LIBRE DE LÁTEX QUE NO REQUIERE AGUJA ENSAMBLADO EN LA LÍNEA; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 290 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 19 ML (SIN TOMAR EN CUENTA EL VOLUMEN DE LA BURETA) SON COMPATIBLES CON BOMBA DE INFUSION PLUM 360

R: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO

PREGUNTA 4

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 A,

CONSUMIBLES :

DICE: EQ. NPT Y EQ. FOTOSENSIBLE ES EL MISMO CODIGO (AQUÍ SE SUMAN AMBAS CANTIDADES) EL CODIGO VLON90 ES EL MISMO PARA AMBOS

DESCRIPCION PROPUESTA

EQUIPO (LÍNEA) DE INFUSIÓN FOTOSENSIBLE LIBRE DE PVC, DEHP Y LATEX PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE PVC Y DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ML MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, SILICÓN.

SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR

CONSUMIBLES : EQ. NPT Y EQ. FOTOSENSIBLE (AQUÍ SE SUMAN AMBAS CANTIDADES) EL CODIGO 14007

DESCRIPCION PROPUESTA

EQUIPO DE INFUSIÓN FOTOSENSIBLE LIBRE DE PVC, DEHP Y LATEX PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE PVC Y DEHP; MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON TECNOLOGÍA DE CASSETTE CUENTA CON CANAL SECUNDARIO QUE PERMITE AL USUARIO REALIZAR UNA O DOS INFUSIONES SIMULTÁNEAS O ALTERNAS Y SACAR EL AIRE DE LA LÍNEA A TRAVÉS DE RETROPURGADO SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR AL PACIENTE; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 272 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 12 ML MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, SILICÓN. SON COMPATIBLE CON BOMBA DE INFUSION PLUM 360

ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA PRACTICA CLINICA AL MISMO COSTO Y SE SURTIRA SEGÚN SUS NECESIDADES

R: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO

PREGUNTA 5

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 A,

CONSUMIBLES :

DICE: EQ. NPT Y EQ. FOTOSENSIBLE ES EL MISMO CODIGO (AQUÍ SE SUMAN AMBAS CANTIDADES) EL CODIGO VLON90 ES EL MISMO PARA AMBOS

DESCRIPCION PROPUESTA

EQUIPO (LÍNEA) DE INFUSIÓN FOTOSENSIBLE LIBRE DE PVC, DEHP Y LATEX PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE PVC Y DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ML MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, SILICÓN.

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SE NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR

CONSUMIBLES: EQ. NPT Y EQ. FOTOSENSIBLE (AQUÍ SE SUMAN AMBAS CANTIDADES) EL CODIGO 15443.

DESCRIPCIÓN PROPUESTA

EQUIPO DE INFUSIÓN PARA NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL (NPT) FOTOSENSIBLE LIBRE DE PVC, DEHP Y LATEX PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE PVC Y DEHP; MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, FILTRO DE 1.2 MICRAS INTEGRDO A LA LINEA CON TECNOLOGÍA DE CASSETTE CUENTA CON CANAL SECUNDARIO QUE PERMITE AL USUARIO REALIZAR UNA O DOS INFUSIONES SIMULTÁNEAS O ALTERNAS Y SACAR EL AIRE DE LA LÍNEA A TRAVÉS DE RETROPURGADO SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR AL PACIENTE; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 259 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 21 ML MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, SILICÓN. SON COMPATIBLE CON BOMBA DE INFUSION PLUM 360

ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA PRACTICA CLINICA AL MISMO COSTO Y SE SURTIRA SEGÚN SUS NECESIDADES

R: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO

PREGUNTA 6

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 A,

CONSUMIBLES :

DICE: EQ. PARA QUIMIOTERAPIA

DESCRIPCIÓN PROPUESTA

EQUIPO (LÍNEA) DE INFUSIÓN LIBRE DE PVC, DEHP Y LATEX PARA QUIMIOTERAPIA Y SOLUCIONES QUE REQUIEREN FILTRO DE 0.2 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE, FLEXIBLE Y CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE PCV Y DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; FILTRO ANTIBACTERIAL Y ELIMINADOR DE AIRE DE 0.2 MICRAS ENSAMBLADO EN LA LÍNEA; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ML MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, SILICÓN.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR

CONSUMIBLES :

EQ. PARA QUIMIOTERAPIA

DESCRIPCION PROPUESTA

EQUIPO DE INFUSIÓN LIBRE DE PVC, DEHP Y LATEX PARA QUIMIOTERAPIA Y SOLUCIONES QUE REQUIEREN FILTRO DE 0.2 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE, FLEXIBLE Y CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE PCV Y DE DEHP;; MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON TECNOLOGÍA DE CASSETTE CUENTA CON CANAL SECUNDARIO QUE PERMITE AL USUARIO REALIZAR UNA O DOS INFUSIONES SIMULTÁNEAS O ALTERNAS Y SACAR EL AIRE DE LA LÍNEA A TRAVÉS DE RETROPURGADO SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR AL PACIENTE; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 272 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 23 ML SON COMPATIBLES CON BOMBA DE INFUSION PLUM 360

R: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO

PREGUNTA 7

PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 A,

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR

BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA CON CASETE (ACCIONADO POR PISTÓN), CANAL PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA INFUSIÓN DE DOS MEDICAMENTOS EN MODO ALTERNATIVO O SIMULTANEO, TECLADO ALFANUMÉRICO QUE PERMITE CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN, DOS SENSORES DE AIRE (DISTAL Y PROXIMAL), OPCIÓN DE BLOQUEO DE TECLADO. KVO AJUSTABLE A LA VELOCIDAD DE FLUJO, FUNCIÓN DE PAUSA, RETRASO Y/O PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA. INFUSIÓN GENERAL Y EPIDURAL. **COMODATO**

PORTA VENOCCLISIS RODABLE:

BARRA DE EXTENSIÓN DE ACERO PARA VENOCCLISIS DE 11.1 A 12.7 MM. (7/16 A 1/2") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. BASE QUÍNTUPLE DE PERFIL DE LAMINA DE ACERO, CAL. NO. 16 MÍNIMO, LASTRADO. CRUCETA CON GANCHOS DE ACERO DE 7.9 A 9.5 MM. (5/16" A 3/8") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. PERILLA PARA FIJACIÓN DE LA EXTENSIÓN TIPO TRINQUETE DE ACERO; ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA DE 50.8 MM. (2") DE HULE COLOR NEGRO. TUBULAR DE ACERO CAL. NO. 18 DE 25.4 MM. A 31.7 MM. (1" A 1 1/4") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO DIMENSIONES GENERALES: 50 MÍNIMO X 50 MÍNIMO X 1.25 HASTA 2.10 CM.

R: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO.

PREGUNTA 7

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES NECESARIO CUMPLIR CON LA UNIDAD DE TECNO VIGILANCIA QUE SE SEÑALA EN LA NOM-240-SSA1-2012 CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE SE ENTREGUEN TENGAN LA FUNCIONALIDAD INDICADA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL PACIENTE
R: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.

PREGUNTAS DEL LICITANTE: EQUIPOS QUIRÚRGICOS POTOSINOS

1. SIENDO ESTE PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS SEA EL PODER OFERTAR PRODUCTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.

R: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.

2. RESPECTO DE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE SOLICITADA EN ORIGINAL (ANEXO 7), SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS SEA PERMITIDO EL PODER PRESENTAR COPIA FIEL JUNTO CON UN ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTA PRESENTADA ES FIEL A SU ORIGINAL Y ESTA ULTIMA ENTREGARLA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS.

R: SE ACEPTA

3. RESPECTO EL TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INFORME EN QUE TIEMPO SERÁN ENTREGADOS DICHS CONSUMIBLES Y EN CUANTAS PARTES O PORCENTAJES.

R: LA ENTREGA SERA MENSUAL Y PODRÁ QUEDA SUJETO A CAMBIO SEGÚN EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA.

LOS PARTICIPANTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON CADA UNO DE LOS PUNTOS ACLARADOS POR LA CONVOCANTE, POR LO ANTERIOR, LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE LAS ACLARACIONES QUE CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN; SE CITA EL DÍA **21 DE JULIO DEL 2021** A LAS **12:00 HORAS** PARA LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA TÉCNICA

LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO A SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, FIRMÁNDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN A CONTINUACIÓN. DÁNDOSE POR TERMINADO EL ACTO A LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2021.

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

C. LIC. ADOLFO MARTÍNEZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


POR EL ÁREA CONTABLE

C. C.P. CELENE MORENO JUÁREZ
POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD


POR EL ÁREA ASESORA

C. LIC. SCARLET NANCY SÁNCHEZ MUÑOZ
ASESOR JURÍDICO

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

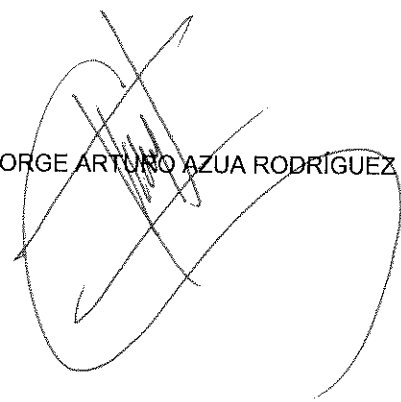

C. MTRO. ULICES ABNER GARCÍA HERNÁNDEZ.
AUDITOR INTERNO

PARTICIPANTES

HOSPIMEDICAL S.A. DE C.V.


C. SUSANA JIMÉNEZ

EQUIPOS QUIRÚRGICOS POTOSINOS S.A. DE C.V.


C. JORGE ARTURO AZUA RODRÍGUEZ