

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL 12 DE MAYO DE 2023, EN LA SALA DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, UBICADA EN: PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850 COL. LOMAS DE LA VIRGEN, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 24 Y 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (EN ADELANTE, LA LEY) ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.1 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE LOS SERVICIOS DE SALUD NO CUENTAN CON EL EQUIPO Y LA TECNOLOGÍA PARA SOLVENTAR LAS DISPOSICIONES MANIFESTADAS EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRORROGAS DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PUBLICADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO PLAN DE SAN LUIS, POR LO CUAL SE PROCEDE A LA GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO CON LOS MEDIOS QUE SE TIENE AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO, ASÍ MISMO SE ENTENDERÁ QUE HAY CONSENTIMIENTO TÁCITO CUANDO PERMANEZCAN EN LAS REUNIONES DE QUE SE TRATE. DE NO EXISTIR CONSENTIMIENTO DEL PARTICULAR, SE LE INFORMA A LOS ASISTENTES QUE NO PODRÁ PERMANECER EN LA REUNIÓN.

ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL ING. CARLOS FEDERICO CARRANZA BENÍTEZ, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN III DE LA LEY, ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A ESTE EVENTO, Y SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO SUS PREGUNTAS CON MÍNIMO 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO COMO SE ESTABLECIÓ EN LA CONVOCATORIA DE FORMA PRESENCIAL O A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO.

EL PRESIDENTE DEL ACTO, DIO INICIO AL ACTO SEÑALANDO QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE:

NO	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
1.-	DRÄGER MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V	CORREO ELECTRÓNICO	23
2.-	MEDSOLUTIONS S.A DE C.V.	PRESENCIAL	14
3.-	VIACOMER S DE R.L DE C.V	CORREO ELECTRÓNICO	61
4.-	MAWA INTEGRAL S.A DE C.V	CORREO ELECTRÓNICO	18
	TOTAL DE PREGUNTAS		116

SE INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO 3.1 JUNTA DE ACLARACION A LAS BASES EN SU PARRAFO SEGUNDO SE LE INFORMA AL PROVEEDOR DRÄGER MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V, QUE SU INASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES ES MOTIVO DE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. SSSLP-LP-N5-2023

DESECHAMIENTO Y POR LO CUAL NO SE CONTESTAN LAS PREGUNTAS RESPECTIVAS, EN ESTE MOMENTO SE SOLICITA A LOS ASISTENTES, LA PRESENTACIÓN DEL RECIBO DE COMPRA DE BASES, CON EL OBJETO DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA PARTICIPAR EN ESTE EVENTO, LOS CUALES SE ANEXAN A ESTA ACTA, SIENDO PRESENTADO POR LOS SIGUIENTES LICITANTES.

NO	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PRESENTACIÓN DEL RECIBO DE COMPRA DE BASES
1.-	DRÄGER MEDICAL DE MEXICO S.A DE C.V	NO SE PRESENTÓ A LA JUNTA DE ACLARACIONES
2.-	MEDSOLUTIONS S.A DE C.V.	SI
3.-	VIACOMER S DE R.L DE C.V	SI
4.-	MAWA INTEGRAL S.A DE C.V	SI

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LA CONVOCANTE SOLICITA UN RECESO, TODA VEZ QUE EL ÁREA TÉCNICA SOLICITA MÁS TIEMPO PARA ANALIZAR Y RESPONDER LAS PREGUNTAS ENVIADAS POR LOS LICITANTES. POR TAL RAZÓN LAS RESPUESTAS SERÁN ATENDIDAS A PARTIR DE LAS 15:00 HORAS, DEL DÍA 12 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, EN SALA DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ UBICADO EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, C.P. 78380, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SIENDO LAS 15:00 HORAS SE CONTINUA CON LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LA CONVOCANTE HACE LA SIGUIENTE PRECISION A LA CONVOCATORIA NO. SSSLP-LP-N5-2023 PRECISION NUMERO 1 UNO.

EN LA PAGINA 324 ANEXO 9 DOCUMENTACION SOLICITADA DEBE DECIR:

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. SSSLP-LP-N5-2023

ANEXO 9

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

No.	DOCUMENTO	REFERENCIA	PRESENTÓ	
			SÍ	NO
TÉCNICO				
4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA				
	PROPUESTA TÉCNICA			
	Original y copia del recibo de la compra de las bases.	A)		
	Constancia del padrón de proveedores SSSLP vigente 2023	B)		
	Anexo 1 Solicitud de cotización	C)		
	Anexo 2 Formato de aclaración de dudas	D)		
	Anexo 3 Acreditación jurídica	E)		

Handwritten signatures and initials



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

Anexo 4 Carta poder simple	F)		
Anexo 5 Periodo de garantía	G)		
Anexo 6 Propuesta Técnica	H)		
Anexo 7 Respaldo de fabricante	I)		
Anexo 8 Formato de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, en papel membretado de la empresa	J)		
Anexo 9 relación de documentos entregados	K)		
Anexo 10 Propuesta económica	L)		
Anexo 11 Requisito establecido en el artículo 48, fracción IX, de la ley de responsabilidades administrativas para el estado y municipios de san luis potosí	M)		
Anexo 12 Formato Fianza de Garantía de Cumplimiento	N)		
Anexo 13. Modelo del Contrato	O)		
Anexo 14 cancelación por retraso en la entrega	P)		
Anexo 15 no sujetos a garantía de cumplimiento	Q)		
Copia de la convocatoria debidamente firmada	R)		
Domicilio fiscal para oír y recibir todo tipo de notificaciones en hoja membretada	S)		
Carta donde manifieste estar de acuerdo con la convocatoria y acuerdos tomados en la junta de aclaraciones	T)		
Copia y original del acta constitutiva	U)		
Validez de las propuestas técnica y económica de 40 días	V)		
Identificación oficial con fotografía de la persona que firme la propuesta	W)		
Constancia de situación fiscal emitida por el SAT	X)		
Último estado financiero autorizado por contador público	Y)		
Declaración Anual Sobre la Renta 2022	Z)		
Parcialidades 2023	AA)		
Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad social Positiva y vigente,, (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato)	BB)		
Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales SAT, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. (Este documento es obligatorio presentarlo al momento de la firma del contrato)	CC)		
Presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en INFONAVIT Positiva y vigente	DD)		
Curriculum de la empresa	EE)		
Relación de trabajos similares	FF)		
Copia de contratos	GG)		
Curriculum del profesional técnico	HH)		
Programa calendarizado	II)		
Relación de herramienta y equipo	JJ)		
Constancia de visita	KK)		
Escrito de encontrarse en sector de micro, pequeñas y medianas empresas..	LL)		
Garantía de seriedad del sostenimiento de la propuesta económica por el 5% (I.V.A. incluido)	MM)		
Anexar memoria USB con las propuestas tanto técnica y económica en digital y en sus formatos originales (Word, Excel).	NN)		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

TODA VEZ QUE ESTE PROCEDIMIENTO ES PRESENCIAL SE PROCEDIO A DAR COPIA CON LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, DANDO 15 QUINCE MINUTOS PARA SU ANALISIS.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR LOS LICITANTES.

1.-PREGUNTAS REALIZADAS POR MEDSOLUTIONS S.A DE C.V.

NUMERO CONSECUTIVO	PUNTO DE LAS BASES	PREGUNTA	RESPUESTA
1	5.-PROPUESTA TÉCNICA LETRA (S)	DEBEMOS ENTENDER QUE EL DOMICILIO, EN CASO DE NO CONTAR CON UBICACIÓN FÍSICA EN SAN LUIS POTOSI, SERÁ EL QUE APARECE EN NUESTRA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
2	PROPUESTA TÉCNICA LETRA (11)	DICE " GRAFICA DE GRANT"" ..", DEBEMOS ENTRENDER QUE SE REFERIERE A LA GRAFICA DE "GANTT", IES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
3	ANEXO 1 RUTINAS DE MANTENIMIENTO	SOBRE LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD LA CONVOCANTE SUGIERE REALIZARLAS DE ACUERDO CON LA IEC-60601-1, ¿SE ACEPTA EN SU LUGAR LA IEC- 62353?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
4	ANEXO 1 RUTINAS DE MANTENIMIENTO	SOBRE EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SE ESPECIFICA 12 HORAS PARA ATENCIÓN, DEBEMOS ENTENDER POR ATENCIÓN LA PRESENCIA DE UN INGENIERO EN EL	ES CORRECTA SU APRECIACION

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. SSSLP-LP-N5-2023

		HOSPITAL INTERESADO, ¿ES CORRECTO?	
5	ANEXO 1 RUTINAS DE MANTENIMIENTO	SOBRE LA CAPACITACIÓN DC-3, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, PODAMOS PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE LAS CAPACITACIONES DC-3 EN TRABAJOS CON ELECTRICIDAD Y/O EN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. DEBEN SER CAPACITACIONES PARA TODOS LOS EQUIPOS MÉDICOS Y MARCAS DEL ANEXO 1 PARTIDA ÚNICA.
6	ANEXO 13 MODELO DE CONTRATO	FAVOR DE CONFIRMAR SI LA PRESENTE LICITACION Y EL CONTRATO DERIVADO DE ESTA, ACEPTAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE EMPRESAS.	ES CORRECTA SU APRECIACION
7	ANEXO 13 MODELO DE CONTRATO	FAVOR DE CONFIRMAR LA PRESENTE LICITACION Y EL CONTRATO DERIVADO DE ESTA, ACEPTAN LA SUBCONTRATACION DE PERSONAL	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, NO SE ACEPTA LA SUBCONTRATACION.
8	5.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO D) ANEXO 2 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE INCLUIRÁ SOLO EL FORMATO ANEXO 2 CON FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, ES DECIR, SIN INCLUIR LAS PREGUNTAS QUE HAYAMOS REALIZADO EN LA JUNTA ACLARATORIA, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO. ADEMÁS DEL FORMATO DEL ANEXO 2, DEBERÁN INCLUIR COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
9	5.- PROPUESTA	DADO A QUE EL	ES CORRECTA SU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. SSSLP-LP-N5-2023

	TECNICA INCISO Q) ANEXO 15 NO SUJETOS A GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	TEXTO DE ESTE ANEXO HACE ALUSIÓN AL LICITANTE ADJUDICADO, DEBEMOS ENTENDER QUE EN LA PROPUESTA TECNICA SE PRESENTARA SOLO EL FORMATO SIN REQUISITAR, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL ¿ES CORRECTO?	APRECIACION
10	5.- PROPUESTA TECNICA INCISO R) COPIA INTEGRAL DE LAS BASES ON ANEXOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL DOCUMENTO CON RUBRICA EN TODAS SUS HOJAS Y CON FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL UNICAMENTE EN LA ULTIMA HOJA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
11	5.- PROPUESTA TECNICA INCISO BB)	DADO A LQUE VIGENCIA DE LA OPINION QUE EMITE EL IMSS VENCE EL MISMO DIA A LAS 23:59, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODAMOS PRESENTAR OPINION VIGENTE CON FECHA DEL DIA ANTERIOR A LA ENTREGA DE PROPUESTAS,¿SE ACEPTA?	PODRA PRESENTAR DICHA CONSTANCIA CON UNA A CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A LOS 3 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
12	5.- PROPUESTA TECNICA INCISO KK)CONST ANCIA DE VISITAS	DEBEMOS ENTENDER QUE LAS VISITAS SE REALIZARAN SOLO A LOS HOSPITALES QUE EL LICITANTE CONSIDERE NECESARIO, Y NO A LA TOTALIDAD DE UNIDADES QUE SE INCLUYEN EN EL ANEXO 1 ¿ES CORRECO?	NO ES CORRECTO. DEBERÁ VISITAR EL 100% DE LAS UIDADES DE SALUD A LAS QUE PERTENECEN LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS. EL NO PRESENTAR UNA CONSTANCIA DE VISITA DE TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE LA PARTIDA ÚNICA DEL ANEXO 1 SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
13	6. PROPUESTA	SE SOLICITA A LA	NO SE ACEPTA SU

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	ECONOMICA INCISO B)	CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODAMOS PRESENTAR FIANZA COMO GARANTIA DE SERIEDAD EN LUGAR DE CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA YA QUE LOS CHEQUES IMPLICAN TENER EL MONTO DETENIDO HASTA QUE SE CONCLUYA EL PROCESO LICITATORIO Y CONTRATO	PROPUESTA DEBERA PRESENTAR CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA Y ESTE SE PUEDE DEVOLVER EN CASO DE SER ADJUDICADO A LA ENTREGA DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE QUE AMPARA EL CONTRATO.
14	6) PROPUESTA ECONOMICA INCISO A) PUNTO 2	RELACION DE ARTICULOS ORIGINALES FAVOR DE CONFIRMAR SI CON "ARTICULOS" SE REFIERE A LAS REFACCIONES O EN CASO CONTRARIO ACLARAR A QUE SE REFIERE	SE REFIERE A LAS REFACCIONES

2.- PREGUNTAS REALIZADAS POR MAWA INTEGRAL S.A DE C.V

NUMERO CONSECUTIVO	PUNTO DE LAS BASES	PREGUNTA	RESPUESTA
1	SECCIÓN I PUNTO 3.2 LA PROPUESTA DEBERÁ ABARCAR EL 100% DE LA PARTIDA ÚNICA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS, CONFORME AL ANEXO 1, DE LAS PRESENTES BASES. NO PRESENTAR TACHADURAS Y ENMENDADURAS. SE DEBERÁ COTIZAR EN EL MISMO ORDEN DEL ANEXO 1, SI ALGÚN RENGLÓN O CLAVE NO ES COTIZADO POR USTED SE PONDRÁ LA FRASE NO COTIZO	AL SOLICITAR QUE LA PROPUESTA DEBERÁ ABARCAR EL 100% DE LA PARTIDA ÚNICA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS, CONFORME AL ANEXO 1, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁN COTIZAR EL 100% DE LOS RENGLONES DE LOS SERVICIOS DEL ANEXO 1 Y AL NO COTIZAR ALGUNO DE LOS RENGLONES SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA OFERTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION , DEBERÁ COTIZAR EL 100% DE LOS RENGLONES QUE SE INCLUYEN EN AL ANEXO I, PARTIDA ÚNICA QUE LO INTEGRAN LAS LISTAS DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMEDICO" Y PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE IMAGENOLOGIA". EL NO COTIZAR UN RENGLÓN DE TODA LA PARTIDA ÚNICA DEL ANEXO 1 SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
2	ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMÉDICO	ENTENDEMOS QUE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PUBLICADAS CORRESPONDEN A RUTINAS PROPIAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL ÁREA BIOMÉDICA. LAS CUALES MENCIONAN LO SIGUIENTE EN EL ANEXO 1 DE LAS RUTINAS: EN LAS RUTINAS SE INDICA QUE TODA ANOMALÍA, GOLPE, RALLADURA, DESPERFECTO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE ENCUENTRE SE DEBE CORREGIR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE	DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES SE REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CON CORRECTIVOS EN RENGLONES ESPECÍFICOS; AL MENCIONAR LA PALABRA CORREGIR EN LOS RENGLONES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE SON MÁS DEL 95% DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, CON ESA PALABRA CAMBIA EL SENTIDO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CORRECTIVO.</p> <p>POR LO ANTES MENCIONADO SOLICITAMOS SEA ACEPTADO DICHO CAMBIO; YA QUE LA PALABRA CORREGIR CAMBIA EL SENTIDO DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO Y ENCARA EL COSTO DEL SERVICIO SOLICITADO.</p>	<p>DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTA COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
3	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMÉDICO EQUIPOS: CAMPÍMETRO, CENTRÍFUGA, CENTRÍFUGA REFRIGERADA Y COLPOSCOPIO. 4.- AMBIENTE: INSPECCIONAR QUE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO SEAN LAS ADECUADAS (TEMPERATURA, HUMEDAD, VIBRACIONES, ETC.) EN CASO CONTRARIO, CORREGIRLAS.</p>	<p>ENTENDEMOS QUE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PUBLICADAS CORRESPONDEN A RUTINAS PROPIAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL ÁREA BIOMÉDICA. LAS CUALES MENCIONAN LO SIGUIENTE EN EL ANEXO 1 DE LAS RUTINAS:</p> <p>4.- AMBIENTE: INSPECCIONAR QUE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO SEAN LAS ADECUADAS (TEMPERATURA, HUMEDAD, VIBRACIONES, ETC.) EN CASO CONTRARIO, CORREGIRLAS</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE SUSTITUYA LA PALABRA CORREGIR POR REPORTAR.</p> <p>YA QUE AL TRATARSE DE UNA PÓLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CON CORRECTIVOS EN RENGLONES ESPECÍFICOS; AL</p>	<p>CUANDO SE ENCUENTREN CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS QUE PUEDAN PONER EN RIESGO LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y POR CONSIGUIENTE LA VIDA O INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS Y/O PACIENTES DEBERA REPORTARSE AL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR ESCRITO.</p>

al



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>MENCIONAR LA PALABRA CORREGIR EN LOS RENGLONES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE SON MÁS DEL 95% DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, CON ESA PALABRA CAMBIA EL SENTIDO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CORRECTIVO.</p> <p>POR LO ANTES MENCIONADO SOLICITAMOS SEA ACEPTADO DICHO CAMBIO; YA QUE LA PALABRA CORREGIR CAMBIA EL SENTIDO DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO Y ENCARECE EL COSTO DEL SERVICIO SOLICITADO.</p>	
4	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMÉDICO</p>	<p>TODA VEZ QUE LA DESCRIPCIÓN DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO ABARCAN MÁS DE 2 PÁGINAS, NO SERÁ NECESARIO QUE SE TRANSCRIBAN EN EL APARTADO DE "ESPACIO DESTINADO A REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO, EN FORMATO LIBRE, PUEDE SER REDACTADO O EN FORMATO DE CHECKLIST, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO" DEL FORMATO 3 ORDEN DE SERVICIO Y SE DEBERÁN ANEXAR COMO CHEKLIST PARA LAS ORDENES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PODRA REPORTARLO COMO LO INDICA, SIEMPRE QUE SE ESTIPULE QUE SE CUMPLA CON ESTAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO MISMAS QUE SERAN DEL MANTENIMIENTO DE LOS JEFES DE MANTENIMIENTO/ BIOMEDICA DE LAS UNIDADES.</p>
5	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMÉDICO</p> <p>EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • "EL PROVEEDOR" DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA, ADEMÁS, LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS, MISMO QUE NO PODRÁN REBASAR EL 40% DEL VALOR UNITARIO POR CADA EQUIPO Y/O EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE LO REQUIERA. LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SE 	<p>CONSIDERANDO QUE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA NO SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1 LOS CONCEPTOS DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR, SE DEBERÁN INCLUIR SÓLO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS MENORES SIN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES CUYO VALOR REBASE EL MONTO DEL COSTO DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO CUAL PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO POR EL COSTO DE LAS REFACCIONES, SE CONSIDERE QUE EL MONTO DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SEA POR VALOR DE HASTA UN 15% DEL VALOR UNITARIO POR CADA EQUIPO Y/O EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE LO REQUIERA Y QUE UNA</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERA APEGARSE Y CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA</p>

9

31

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	<p>REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EL DIAGNÓSTICO VALIDADO POR LA UNIDAD MÉDICA AFECTADA Y LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE, CUYO ÚNICO PROPÓSITO SERÁ EL DE CONTROLAR EL PORCENTAJE MARCADO EN ESTE APARTADO.</p>	<p>VEZ ALCANZADO ESTE VALOR, LOS DEMÁS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SE REALICEN A DEMANDA Y CON COSTO ADICIONAL AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO TAMBIÉN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS DEFECTOS Y DAÑOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS EQUIPOS DURANTE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, QUE SE HACEN REFERENCIA EN LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS ELECTROMECAÓNICOS DE LAS PRESENTES BASES. ¿SE ACEPTA?</p>	
6	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMÉDICO</p> <p>ACOMODO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A DISTINTOS MODOS DE ESTUDIO, ACOMPAÑADO DE UN DICTAMEN TÉCNICO DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS FIRMADO POR EL ÁREA USUARIA Y JEFE DE MANTENIMIENTO. 	<p>LA SOLICITUD DE SERVICIOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, MÁS DEL 95 % SE REFIEREN A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; POR LO CUAL ESTOS SE LLEVARÁN A CABO EN UN PROGRAMA CALENDARIZADO, Y AL SER UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>POR LO ANTES MENCIONADO ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A QUE SE DEBA ACOMPAÑAR DE UN DICTAMEN TÉCNICO, SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR LA ORDEN SE SERVICIO DE ACUERDO A LA RUTINA SOLICITADA, DONDE SE MENCIONA QUE EL EQUIPO SE RECIBIÓ EN FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES INCORRECTA SU APRECIACION EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS QUE SE DESGLOSAN AL INICIO DE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO ESTO INCLUYE LA ORDEN DE SERVICIOS CON AL MENOS LOS DATOS QUE SE ESTIPULAN EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE ADEMAS DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADORES Y SIMULADORES CERTIFICADOS ADEMAS QUE EN EL REPORTE DE PRUABAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DEBERA ANEXAR UN APARTADO CON LAS RESPUESTAS TÉCNICAS QUE SE OBTENGAN</p>
7	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMÉDICO</p> <p>ACOMODO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS. PARA MEJOR REFERENCIA, EN ESTE ANEXO ENCONTRARÁ LA REFERENCIA VISUAL PARA EL ACOMODO Y PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, DONDE,</p>	<p>ENTENDEMOS QUE PARA LOS DOCUMENTOS A QUE HACE REFERENCIA EL ANEXO 1 EN EL APARTADO DOCUMENTACION QUE DEBERÁ PRESENTAR "EL LICITANTE" EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y QUE YA SE ENCUENTREN SOLICITADOS EN LA LISTA DEL ANEXO 9, BASTARÁ CON PRESENTARLOS COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA SECCION II, PUNTO 5 PROPUESTA TÉCNICA Y NO SERÁ OBLIGATORIO VOLVERLOS A PONER COMO DOCUMENTOS QUE INTEGREN EL ANEXO 1 EN LAS RUTINAS DE</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACION, LOS DOCUMENTOS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I, PARTIDA ÚNICA Y QUE YA ESTÁN RELACIONADOS EN AL ANEXO 9 Y QUE SE SOLICITAN EN LA SECCIÓN II, PUNTO 5 PROPUESTA TÉCNICA, YA NO SERÁ NECESARIO VOLVERLOS A INTEGRAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA EN EL ANEXO I, PARTIDA ÚNICA.</p>

Handwritten signatures and initials



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	<p>ADEMÁS, SE REALIZAN PRECISIONES TÉCNICAS DEL FORMATO.</p>	<p>MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMÉDICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
8	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE IMAGENOLOGIA" INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ</p> <p>C.S. SANTA MARÍA DEL RÍO</p> <p>RENGLON 96</p>	<p>EN EL RENGLÓN 96 SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS EQUIPOS, UNA DIGITALIZADORA Y UNA IMPRESORA DE LA MARCA FUJIFILM MODELOS DRYPIX Y 2000, NÚMEROS DE SERIE 96132416 Y 96734311.</p> <p>YA QUE SON 2 EQUIPOS EN UN SOLO RENGLÓN SE DEBERÁ REALIZAR UN SOLO REPORTE DE SERVICIO CON LOS DATOS DE AMBOS EQUIPOS. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACION EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERA REPORTARLO COMO INDICA</p>
9	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE IMAGENOLOGIA" INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ</p> <p>H.B.C. TAMAZUNCHALE</p> <p>RENGLONES 137 Y 138</p>	<p>EN LOS RENGLONES 137 Y 138 SE SOLICITA MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DIGITALIZADOR E IMPRESORA LÁSER RESPECTIVAMENTE CON EL MISMO MODELO Y MISMO NÚMERO DE SERIE. EN SUS ORDENES DE SERVICIO CORRESPONDIENTES SE LES PONDRÁ EL MISMO MODELO Y NÚMERO DE SERIE? ¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACION EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERA REPORTARLO COMO INDICA</p>
10	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA.</p>	<p>ENTENDEMOS QUE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PUBLICADAS CORRESPONDEN A RUTINAS PROPIAS DE MANTENIMIENTO SUGERIDAS POR EL ÁREA BIOMÉDICA. LAS CUALES MENCIONAN LO SIGUIENTE EN EL ANEXO 1 DE LAS RUTINAS:</p> <p>EN LAS RUTINAS DONDE SE INDICA LA REPARACIÓN O REPLAZO PIEZAS DEFECTUOSAS DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE SUSTITUYA LA PALABRA REPARACIÓN O REPLAZO POR REPORTAR.</p> <p>YA QUE AL TRATARSE DE UNA PÓLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CON CORRECTIVOS EN RENGLONES ESPECÍFICOS; AL MENCIONAR LA PALABRA CORREGIR EN LOS RENGLONES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE SON MÁS DEL</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES SE REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE</p>


[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>95% DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, CON ESA PALABRA CAMBIA EL SENTIDO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CORRECTIVO.</p> <p>POR LO ANTES MENCIONADO SOLICITAMOS SEA ACEPTADA DICHO CAMBIO; YA QUE LA PALABRA CORREGIR CAMBIA EL SENTIDO DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO Y ENCARECE EL COSTO DEL SERVICIO SOLICITADO.</p>	<p>LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
11	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA.</p>	<p>TODA VEZ QUE LA DESCRIPCIÓN DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO ABARCAN MÁS DE 2 PÁGINAS, NO SERÁ NECESARIO QUE SE TRANSCRIBAN EN EL APARTADO DE "ESPACIO DESTINADO A REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO, EN FORMATO LIBRE, PUEDE SER REDACTADO O EN FORMATO DE CHECKLIST, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO" DEL FORMATO 3 ORDEN DE SERVICIO Y SE DEBERÁN ANEXAR COMO CHEKLIST PARA LAS ORDENES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PODRA REPORTARLO COMO LO INDICA, SIEMPRE QUE SE ESTIPULE QUE SE CUMPLA CON ESTAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO MISMAS QUE SERAN DEL MANTENIMIENTO DE LOS JEFES DE MANTENIMIENTO/ BIOMEDICA DE LAS UNIDADES.</p>
12	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA.</p> <p>EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • "EL PROVEEDOR" DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA, ADEMÁS, LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON 	<p>CONSIDERANDO QUE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA NO SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1 LOS CONCEPTOS DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR, SE DEBERÁN INCLUIR SÓLO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS MENORES SIN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES CUYO VALOR REBASE EL MONTO DEL COSTO DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO CUAL PARA</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERA APEGARSE Y CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA</p>


[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	REFACCIONES INCLUIDAS, MISMOS QUE NO PODRÁN REBASAR EL 40% DEL VALOR UNITARIO POR CADA EQUIPO Y/O EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE LO REQUIERA. LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SE REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EL DIAGNÓSTICO VALIDADO POR LA UNIDAD MÉDICA AFECTADA Y LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE, CUYO ÚNICO PROPÓSITO SERÁ EL DE CONTROLAR EL PORCENTAJE MARCADO EN ESTE APARTADO.	NO AFECTAR EL PRESUPUESTO POR EL COSTO DE LAS REFACCIONES, SE CONSIDERE QUE EL MONTO DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SEA POR VALOR DE HASTA UN 15% DEL VALOR UNITARIO POR CADA EQUIPO Y/O EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE LO REQUIERA Y QUE UNA VEZ ALCANZADO ESTE VALOR, LOS DEMÁS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SE REALICEN A DEMANDA Y CON COSTO ADICIONAL AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO TAMBIÉN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE INCLUYAN REPARACIÓN O REPLAZO PIEZAS DEFECTUOSAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS EQUIPOS DURANTE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, QUE SE HACEN REFERENCIA EN LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS PRESENTES BASES. ¿SE ACEPTA?	
13	ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA ACOMODO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS. • PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A DISTINTOS MODOS DE ESTUDIO, ACOMPAÑADO DE UN DICTAMEN TÉCNICO DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS FIRMADO POR EL ÁREA USUARIA Y JEFE DE MANTENIMIENTO.	LA SOLICITUD DE SERVICIOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, MÁS DEL 95 % SE REFIEREN A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; POR LO CUAL ESTOS SE LLEVARÁN A CABO EN UN PROGRAMA CALENDARIZADO, Y AL SER UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO. POR LO ANTES MENCIONADO ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A QUE SE DEBA ACOMPAÑAR DE UN DICTAMEN TÉCNICO, SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR LA ORDEN SE SERVICIO DE ACUERDO A LA RUTINA SOLICITADA, DONDE SE MENCIONA QUE EL EQUIPO SE RECIBIÓ EN FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO DESPUÉS DE SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES INCORRECTA SU APRECIACION EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS QUE SE DESGLOSAN AL INICIO DE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO ESTO INCLUYE LA ORDEN DE SERVICIOS CON AL MENOS LOS DATOS QUE SE ESTIPULAN EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE ADEMÁS DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON FANTOMAS Y EN DIFERENTES MODOS DE ESTUDIO ADEMÁS QUE EL REPORTE DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DEBERA ANEXAR UN APARTADO CON LA INTERPRETACION TECNICA DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN
14	ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA ACOMODO DE	ENTENDEMOS QUE PARA LOS DOCUMENTOS A QUE HACE REFERENCIA EL ANEXO 1 EN EL APARTADO DOCUMENTACION QUE DEBERÁ PRESENTAR "EL LICITANTE" EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y QUE YA SE	ES CORRECTA SU APRECIACION, LOS DOCUMENTOS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO I, PARTIDA ÚNICA Y QUE YA ESTÁN RELACIONADOS EN AL ANEXO 9 Y QUE SE

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	DOCUMENTACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADOS. PARA MEJOR REFERENCIA, EN ESTE ANEXO ENCONTRARÁ LA REFERENCIA VISUAL PARA EL ACOMODO Y PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, DONDE, ADEMÁS, SE REALIZAN PRECISIONES TÉCNICAS DEL FORMATO.	ENCUENTREN SOLICITADOS EN LA LISTA DEL ANEXO 9, BASTARÁ CON PRESENTARLOS COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA SECCION II, PUNTO 5 PROPUESTA TÉCNICA Y NO SERÁ OBLIGATORIO VOLVERLOS A PONER COMO DOCUMENTOS QUE INTEGREN EL ANEXO 1 EN LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SOLICITAN EN LA SECCIÓN II, PUNTO 5 PROPUESTA TÉCNICA, YA NO SERÁ NECESARIO VOLVERLOS A INTEGRAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA EN EL ANEXO I, PARTIDA ÚNICA.
15	ANEXO 1 PARTIDA UNICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ÁREAS DE INGENIERÍA CLÍNICA Y DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN SE TOMARÁ EN CUENTA LOS SIGUIENTES FORMATOS FORMATO 3.- ORDEN DE SERVICIO	EL FORMATO PRESENTADO ES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO Y LA UBICACIÓN DEL FOLIO SE PUEDE PONER AL LADO SUPERIOR DERECHO EN FORMATO DEL PROVEEDOR Y NO SERÁ NECESARIO INTEGRAR EL LOGOTIPO DE LOS SSSLP SIEMPRE Y CUANDO SE CONTEMPLAN TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION., SE DEBERÁ TOMAR COMO BASE MÍNIMA LOS ESPACIOS Y DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE.
16	ANEXO 5 PARTIDA UNICA PERIODO DE GARANTÍA POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO MANIFESTAR A USTED QUE EL PERIODO DE GARANTÍA Y CADUCIDAD DE LA TOTALIDAD DEL SERVICIO QUE ESTAMOS COTIZANDO, SERA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES SOLO APLICA EN CASOS DE ENTREGAR PIEZAS QUE INCLUYA GARANTIA	TODA VEZ DE QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y NO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE LA GARANTÍA SEA DE 45 DÍAS PARA ACCESORIOS, PARA PARTES Y REFACCIONES QUE SE INCLUYAN EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A PARTIR DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
17	ANEXO 7 RESPALDO DEL FABRICANTE POR CUANTO ____ (NOMBRE DEL FABRICANTE) _____, FABRICANTE ESTABLECIDO DE (EQUIPO O BIEN QUE FABRICA), CON FABRICA UBICADA EN (DOMICILIO DEL FABRICANTE, SEÑALANDO, C.P., CIUDAD, TEL. Y CORREO ELECTRÓNICO) Y CAPACIDAD SUFICIENTE	TODA VEZ QUE SE TRATA DE UNA LICITACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y NO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN EL ANEXO 7 SE ACEPTEN CARTAS DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DEL IMPORTADOR PRIMARIO HACIA EL PROVEEDOR, DONDE SE LE AUTORIZA A REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON APOYO DE REFACCIONES DE LA O LAS MARCAS QUE FABRICA	SE ACEPTA SU PROPUESTA

[Handwritten signatures and initials]




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	DE PRODUCCIÓN DE LOS BIENES QUE SE PRETENDEN ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA LICITACIÓN NO. _____.	O REPRESENTA, LO ANTERIOR ES CONSIDERANDO QUE LAS CARTAS DE APOYO A LICITACIONES DE ADQUISICIONES SE DAN POR LICITACIÓN, MIENTRAS QUE LAS CARTAS DE APOYO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NORMALMENTE SE DAN AL PROVEEDOR CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DE SU AUTORIZACIÓN. ¿SE ACEPTA?	
18	ANEXO 9 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 4.1. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA	ENTENDEMOS QUE LA REFERENCIA DE LOS INCISOS CORRESPONDERÁN A LOS INCISOS DE LA SECCIÓN II, PUNTO 5 PROPUESTA TÉCNICA, POR LO CUAL SE DEBE TODOS SUS INCISOS EN FORMA CONSECUTIVA INCLUYENDO EL INCISO: KK. CONSTANCIAS DE VISITA (ANEXO 16)	FAVOR DE REMITIRSE A LA PRECISION NUMERO 1 DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.

3.- PREGUNTAS REALIZADAS POR VIACOMER S DE R.L DE C.V

NUMERO CONSECUTIVO	PUNTO DE LAS BASES	PREGUNTA	RESPUESTA
1	SECCION II 5. PROPUESTA TECNICA INCISO NN.	5. PROPUESTA TECNICA. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPUESTAS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS. INCISO NN. ANEXAR MEMORIA USB CON LAS PROPUESTAS TANTO TÉCNICA Y ECONÓMICA EN DIGITAL Y EN SUS FORMATOS ORIGINALES (WORD Y EXCEL) ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS ARCHIVOS EN FORMATO WORD, EXCEL. SE ACEPTEN SIN FIRMA DIGITAL DEL REPRESENTANTE LEGAL POR CONCEPTO DE SEGURIDAD DE DOCUMENTO SE ACEPTA? FAVOR DE CONFIRMAR.	SE ACEPTA SU PROPUESTA.

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

2	SECCION II 5. PROPUESTA TECNICA INCISO S	5. PROPUESTA TECNICA INCISO S LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CARTA SEÑALANDO SU DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE SAN LUÍS POTOSÍ PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES O REQUERIMIENTOS DERIVADOS DE ESTA LICITACIÓN EN CASO DE CONTAR CON ÉL O EN SU DEFECTO EL DOMICILIO FISCAL DE ORIGEN, ASÍ COMO CORREO ELECTRÓNICO. ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ TENER DOMICILIO OBLIGATORIO EN EL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ, ES CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION PODRA SEÑALAR EL DOMICILIO FISCAL DE ORIGEN.
3	SECCION IV MODELO DE ANEXOS ANEXO 12 FIANZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	EN CASO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EL NOMBRE Y DATOS DE CADA UNO DE ELLOS. ¿LA PRESENTE LICITACIÓN ACEPTA PARTICIPACIÓN CONJUNTA? ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SU PROPUESTA Y DEBERA ADJUNTAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE..
4	SECCION IV MODELOS DE ANEXOS ANEXO 13 MODELO DE CONTRATO	A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA LAS PARTES. ¿LA PRESENTE LICITACIÓN ACEPTA PARTICIPACIÓN CONJUNTA? ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION Y DEBERA ADJUNTAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
5	DATOS GENERALES DE LA LICITACION CALENDARIO DE LICITACION VISITAS A LAS UNIDADES SECCION II 1.- CALENDARIO DE EVENTOS VISITAS A LAS UNIDADES	CALENDARIO DE LICITACIÓN/EVENTOS DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO 2023 DE 8:00 A 15:00 HRS. CONSIDERANDO QUE EL 13 Y 14 DE MAYO (FIN DE SEMANA). ¿EN ESOS DÍAS SE PODRÁ REALIZAR LA VISITA A LAS UNIDADES? FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTO, SE PODRÁN VISITAR LAS UNIDADES SIEMPRE Y CUANDO SE NOTIFIQUE PREVIAMENTE AL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL DÍA VIERNES 12 DE MAYO.
6	SECCION IV ANEXO 09 DOCUMENTACION SOLICITADA	DE LA LISTA DE ESTE ANEXO DEBEN SER LOS MISMOS INCISOS SOLICITADOS EN LA SECCIÓN II, PUNTO 5 PROPUESTA TECNICA DE LAS PRESENTES BASES ¿ES CORRECTO?	FAVOR DE REMITIRSE A LA PRECISION NUMERO 1 A LA CONVOCATORIA DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES
7	ANEXO 1 PARTIDA UNICA ROUTINAS DE	ÉSTA NORMA ESTÁ ENFOCADA A LAS INSTALACIONES	ES CORRECTA SU APRECIACION

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	<p>MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>GENERALES</p> <p>SE HACE REFERENCIA A LA NOM-001-SEDE-2012, ART 517 EN PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA</p>	<p>ELÉCTRICAS EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LA SALUD, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA SOLO SEA NECESARIO MEDIR EL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE CA (FASE, NEUTRO Y TIERRA) DEL EQUIPO Y QUE EN CASO DE ENCONTRAR VALORES FUERA DE RANGO QUE PUDIERAN AFECTAR AL EQUIPO, SE REPORTEN EN EL FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO O EN EL CHECKLIST.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
8	<p>ANEXO 1</p> <p>PARTIDA UNICA</p> <p>RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>GENERALES</p> <p>EN EL APARTADO DE INSPECCIÓN DE COMPONENTES SE MENCIONA: EN CASO DE ENCONTRAR ANOMALÍAS CORREGIRLAS Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS COMO CABLES DE RED Y/O FUSIBLES EN CASO DE SER NECESARIO.</p>	<p>CONSIDERAMOS QUE ESTE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</p> <p>ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICAS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE</p>

al

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

			<p>SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
<p>9</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>GENERALES</p> <p>INSPECCIÓN GENERAL ESTADO DE ESTRUCTURA. INSPECCIONAR EL ESTADO FÍSICO DE LA CARCASA DEL EQUIPO, EN BUSCA DE ALGÚN GOLPE, RALLADURA, O DESPERFECTO. EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN DAÑO, CORREGIRLO Y/O SUSTITUIR LA PARTE AFECTADA.</p>	<p>CONSIDERAMOS QUE ESTE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CORRECCIÓN DE DAÑO, Y/O SUSTITUIR LA PARTE AFECTADA. EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES SE REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE</p>

ca

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

			ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.
10	ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO GENERALES VERIFICACIÓN FINAL MENCIONA SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (LISTA DE CHEQUEO).	CONSIDERAMOS QUE EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES NO APLICA PARA ESTA LICITACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO SE ENTREGARAN CONSUMIBLES COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION., SIN EMBARGO DADO DE QUE POR FALTA DE ACCESORIOS EL EQUIPO NO CUMPLA SU FUNCION DEBERA REPORTAR AL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Y AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA QUE SE AUTORICE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTOS.
11	ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO GENERALES TIEMPO DE RESPUESTA PARA CORRECTIVO: SE HACE MENCIÓN A UN TIEMPO DE RESPUESTA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 12 HORAS PARA ATENCIÓN.	EN EL ENTENDIDO DE QUE ES UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y DE QUE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS INCLUIDOS SE ATENDERÁN DE ACUERDO AL CALENDARIO DE VISITAS A LAS UNIDADES SOLICITAMOS QUE ESTE TIEMPO EN TODO CASO SE INICIE A PARTIR DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS CORRECTIVOS AUTORIZADOS Y CON UN TIEMPO DE ATENCIÓN NO MAYOR A 48 HORAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. EL PROVEEDOR ADJUDICADO CONTARA CON 12 DOCE HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION PARA PRESENTARSE EN LA UNIDAD AFECTADA Y COMENZAR LA ATENCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EL PLAZO PARA CONCLUIR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO PUEDE SER MAYOR A 48 CUARENTA Y OCHO HORAS.
12	ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. PRUEBAS DE	EN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA QUE EN CASO DE ALGUNOS CONSUMIBLES COMO SENSORES DE SPO2, SE REALICE CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO, MISMO CASO PARA LA SONDA DE TEMPERATURA.	ES CORRECTA SU APRECIACION., SIN EMBARGO DADO DE QUE POR FALTA DE ACCESORIOS EL EQUIPO NO CUMPLA SU FUNCION DEBERA REPORTAR AL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Y AL

dey

el

[Handwritten signatures and marks]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	<p>FUNCIONAMIENTO.</p> <p>REEMPLAZO DE BATERÍA</p>	<p>EN REEMPLAZO DE BATERÍA MENCIONA RETIRAR BATERÍA EN CASO DE SER NECESARIO Y REEMPLAZAR EN CASO DE REQUERIR.</p> <p>LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES NO ESTÁN CONSIDERADOS COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO CUAL SE PODRÁN INCLUIR COMO PARTES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS; LOS CUALES SE COTIZARÁN POR APARTE.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA QUE SE AUTORICE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTOS</p>
13	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: TORRE DE LAMPAROSCOPIA.</p> <p>INSUFLADOR MENCIONA "VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTORES DE PRESIÓN. CORREGIR DEFICIENCIAS EN CASO DE SER NECESARIO"</p>	<p>CONSIDERAMOS QUE ESTE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</p> <p>ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICAS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE</p>

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

			SERVICIO SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.
14	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE.</p> <p>VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO FOTOTERAPIA (EN CASO DE QUE CUENTE CON LA OPCIÓN)</p>	<p>EN LA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA LO SIGUIENTE EN CASO DE QUE EL COLCHÓN O CAPACETE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO SUSTITUIR POR UNOS DE CARACTERÍSTICAS IGUALES.</p> <p>FOTOTERAPIA (EN CASO DE QUE CUENTE CON LA OPCIÓN) MENCIONA QUE SI NO SE ALCANZA LOS VALORES SE DEBERÁN CAMBIAR LOS TUBOS DE FOTOTERAPIA LO MISMO APLICA PARA EL BALASTRO.</p> <p>LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES NO ESTÁN CONSIDERADOS COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO CUAL SE PODRÁN INCLUIR COMO PARTES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS; LOS CUALES SE COTIZARÁN POR APARTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>PARA EL CASO DE CAPACETE DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PARA LAS LAMPARAS DE FOTOTERAPIA EL CAMBIO DE TUBOS FORMA PARTE INTEGRAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE SIN ESTA PARTE FUNDAMENTAL EL EQUIPO POR SI MISMO ES INCAPAZ DE CUMPLIR SU FUNCION POR LO QUE DE ENCONTRARSE EN MALAS CONDICIONES O QUE NO CUMPLA CON LA LONGITUD DE ONDA DEBERA SUSTITUIRSE.</p>
15	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: VENTILADOR MECÁNICO.</p>	<p>EN LA INSPECCIÓN GENERAL. ACCESORIOS (CABLE DE ALIMENTACIÓN, CIRCUITO DE PACIENTE Y CELDA DE 02) SI ES NECESARIO DEBERÁN SER SUSTITUIDOS Y SE</p>	<p>ES INCORRECTA SU APRECIACION EL KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FORMA PARTE VITAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VENTILADORES MISMO</p>

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	<p>INSPECCIÓN GENERAL. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>	<p>DEBERÁ SUMINISTRAR UN CIRCUITO PACIENTE REUTILIZABLE.</p> <p>PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SE MENCIONA QUE SI ES NECESARIO HAY QUE SUSTITUIR EL HUMIFICADOR DE GAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • COMPROBACIÓN DE LA VÁLVULA ESPIRATORIA EN CASO DE DAÑO O MAL FUNCIONAMIENTO SE DEBERÁ CORREGIR O SUSTITUIR. LO MISMO APLICA PARA LA VÁLVULA DE SEGURIDAD, PARA EL CONTROL DE NEBULIZADOR DE MEDICAMENTOS EL SENSOR DE O2 Y EL SENSOR DE FLUJO. REEMPLAZO DE BATERÍA EN CUANTO A LAS BATERÍAS SE MENCIONA "RETIRAR BATERÍA EN CASO DE SER NECESARIO Y REEMPLAZAR CON UNA BATERÍA ADECUADA EN CASO DE REQUERIR". SE SUGIERE REPORTAR. <p>KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p> <p>1.- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL CAMBIO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL EQUIPO DE VENTILACIÓN, EL CUAL DEBERÁ DE CONSISTIR EN, AL MENOS LOS SIGUIENTES ELEMENTOS, LOS CUALES NO SON LIMITATIVOS Y DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO Y EN LA NORMATIVA APLICABLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SENSOR DE OXÍGENO. • SENSOR DE FLUJO. • JUEGO DE EMPAQUES Y "O" RINGS. • BATERÍA 12V DE RESPALDO (EN CASO DE TERMINO DE VIDA ÚTIL O CADUCIDAD). • BATERÍA 3V (RELOJ). 	<p>QU DEBERA INCLUIR AL MENOS LOS ELEMENTOS SEÑALADOS EN LA RUTINA DE MANTENIMIENTO Y70 SUPERIORES DE ACUERDO A LOS MANUALES DE SERVICIO DE LOS EQUIPOS PARA LOS DEMAS .REFACCIONES DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>
--	--	--	---

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<ul style="list-style-type: none"> JUEGO DE FILTROS DE ENTRADA DE AIRE. FUELLE (SI APLICA). <p>LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES NO ESTÁN CONSIDERADOS COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO CUAL SE PODRÁN INCLUIR COMO PARTES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS; LOS CUALES SE COTIZARÁN POR APARTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
16	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: MÁQUINA DE ANESTESIA</p> <p>PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA QUE EN CASO DE SI ESTÁ MAL EL HUMIFICADOR CAMBIARLO. LO MISMO APLICA PARA LA VÁLVULA ESPIRATORIA, VÁLVULA DE SEGURIDAD, CONTROL DE NEBULIZADOR DE MEDICAMENTOS, SENSOR DE O2 Y SENSOR DE FLUJO.</p>	<p>EN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA QUE EN CASO DE SI ESTÁ MAL EL HUMIFICADOR CAMBIARLO.</p> <p>LO MISMO APLICA PARA LA VÁLVULA ESPIRATORIA, VÁLVULA DE SEGURIDAD, CONTROL DE NEBULIZADOR DE MEDICAMENTOS, SENSOR DE O2 Y SENSOR DE FLUJO.</p> <p>LOS HUMIDIFICADORES Y NEBULIZADORES NO SON ACCESORIOS PROPIOS DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA SIN EMBARGO EN CASO DE QUE CUENTEN CON ELLOS ADEMÁS DE LA CAL SODADA Y VAPORIZADORES, LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES NO ESTÁN CONSIDERADOS COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO CUAL SE PODRÁN INCLUIR COMO PARTES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS; LOS CUALES SE COTIZARÁN POR APARTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE</p>

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

			DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.
17	ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO EQUIPO: INCUBADORA ESTACIONARIA O DE TRASLADO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	EN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN CASO DEL MOTOR- VENTILADOR MENCIONA QUE DEBERÁ AJUSTARSE Y/O SUSTITUIR. LO MISMO APLICA PARA TUBOS DE FOTOTERAPIA Y BALASTRO. SE SUGIERE QUE EN LUGAR DE SOLICITAR "CORREGIR", SE CAMBIE POR SE DEBERÁ REPORTAR PARA REPARAR Y/O INFORMAR SOBRE LA NECESIDAD DE SUSTITUCIÓN DEL MISMO EN LA ORDEN DE SERVICIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. PARA EL CASO DE LOS TUBOS DE FOTOTERAPIA DEBERA REEMPLAZARSE EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE FUERA DE LA LONGITUD DE ONDA ESTABLECIDA YA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PARA LAS DEMAS PIEZAS CUANDO NO FUERA POSIBLE SU REPARACION DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
18	ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO EQUIPO: ASPIRADOR DE SECRECIONES SISTEMA DE AIRE	EN EL SISTEMA DE AIRE SE MENCIONA VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LA MANGUERA EN CASO CONTRARIO DEBERÁ SUSTITUIRLO. SUSTITUCIÓN DE FILTRO DE AIRE Y REALIZAR LUBRICACIÓN DE MEMBRANA, EN CASO DE DESGASTE MAYOR DEBERÁ SUSTITUIRSE. LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES NO ESTÁN CONSIDERADOS COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO CUAL SE PODRÁN INCLUIR COMO PARTES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS; LOS CUALES SE COTIZARÁN POR APARTE.	LA SUSTITUCION DE FILTROS DE ENTRADA DE AIRE Y LUBRICACION DE MEMBRANA FORMAN PARTE INTEGRAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
19	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA.</p> <p>INSPECCIÓN DE COMPONENTES.</p>	<p>EN EL APARTADO DE INSPECCIÓN DE COMPONENTES MENCIONA VERIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES CORREGIR ANOMALÍAS EN CASO DE SER NECESARIO.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICAS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE</p>

25

CA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

<p>20</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: DESFIBRILADOR- MONITOR</p> <p>REEMPLAZO DE BATERÍA 1.- RETIRAR LA BATERÍA, EN CASO DE SER NECESARIO (VIGENCIA O VIDA ÚTIL), SEGÚN LO INDICADO EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO Y REEMPLAZAR CON UNA BATERÍA ADECUADA.</p>	<p>EN EL APARTADO REEMPLAZO DE BATERÍA MENCIONA RETIRAR LA BATERÍA, EN CASO DE SER NECESARIO (VIGENCIA O VIDA ÚTIL), SEGÚN LO INDICADO EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO Y REEMPLAZAR CON UNA BATERÍA.</p> <p>LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES NO ESTÁN CONSIDERADOS COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO CUAL SE PODRÁN INCLUIR COMO PARTES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>SALUD.</p> <p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTA COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
-----------	---	---	---

Handwritten signatures and initials



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

<p>21</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: LÁMPARA DE FOTOTERAPIA</p> <p>ACCESORIOS</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA CAMBIAR LAS LÁMPARAS (TUBOS DE FOTOTERAPIA Y/O BALASTROS EN CASO DE SER NECESARIO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS PERMISIBLES O EXISTAN FALLAS SE DEBERÁN CAMBIAR LOS TUBOS DE FOTOTERAPIA.</p> <p>LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES NO ESTÁN CONSIDERADOS COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO CUAL SE PODRÁN INCLUIR COMO PARTES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS; LOS CUALES SE COTIZARÁN POR APARTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>LOS TUBOS PARA LA LAMPARA DE FOTOTERAPIA SON UN ELEMENTO INTEGRAL DEL MANTENIMIENTO RPEVENTIVO YA QUE SIN ESTAS EL EQUIPO POR SI MISMO NO SERIA CAPAZ DE REALIZAR SU FUNCION PRIMORDIAL POR LO QUE DE CONTARSE DISFUNCIONALES O FUERA DE LA LONGITUD DE ONDA PERMITIDA DEBERA REEMPLAZARSE COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>
<p>22</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO</p> <p>ACCESORIOS</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, LATIGUILLOS PARA ECG, IMPRESORA ENTRE OTROS) EN CASO DE ENCONTRAR DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRSE.</p> <p>LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES NO ESTÁN CONSIDERADOS COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO CUAL SE PODRÁN INCLUIR COMO PARTES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS; LOS CUALES SE COTIZARÁN POR APARTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE</p>

27



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

			<p>OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
<p>23</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: AGITADORES</p> <p>ACCESORIOS</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN) EN CASO DE ENCONTRAR DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRSE.</p> <p>PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MÓDULO DE CONTROL, EN CASO DE QUE LA BOTONERA NO FUNCIONE ADECUADAMENTE SE DEBERÁ CORREGIR LA FALLA.</p> <p>LAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES NO ESTÁN CONSIDERADOS COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO CUAL SE PODRÁN INCLUIR COMO PARTES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS; LOS CUALES SE COTIZARÁN POR APARTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICAS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

			<p>YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
24	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: CAMPÍMETRO.</p> <p>CONDICIONES AMBIENTALES DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO SEAN LAS ADECUADAS (TEMPERATURA HUMEDAD, VIBRACIONES ETC.) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO</p>	<p>EN EL APARTADO DE CONDICIONES AMBIENTALES MENCIONA INSPECCIONAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO SEAN LAS ADECUADAS (TEMPERATURA HUMEDAD, VIBRACIONES ETC.) EN CASO CONTRARIO CORREGIRLAS. ENTENDEMOS QUE LAS CONDICIONES AMBIENTALES NO SON PARTE DEL EQUIPO.</p> <p>EN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA (ILUMINACIÓN) REVISAR QUE LA LÁMPARA DE PROYECCIÓN DE ESTÍMULO SE ENCUENTRE TRABAJANDO CORRECTAMENTE Y QUE EL CAMPO DE ILUMINACIÓN SEA EL ADECUADO, EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ SUSTITUIR LA LÁMPARA. VERIFICAR QUE LA BOMBILLA DE ILUMINACIÓN DE FONDO REALICE LA ILUMINACIÓN</p>	<p>DADO EL CASO DE QUE SE DETECTEN CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS QUE PUEDAN COMPROMETER LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DEBERA ELABORAR UN REPORTE DE LAS MISMAS Y ENTREGARLO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASI COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y PARA EL RESTO DE LOS ACCESORIOS DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>CORRECTA DE LA CÚPULA EN CASO CONTRARIO REEMPLAZAR LA LUMINARIA. •BOTONES Y PANTALLAS REALIZAR LA REVISIÓN DEL BOTÓN DE RESPUESTA DE PACIENTE EN CASO DE QUE NO FUNCIONE CORRECTAMENTE O PRESENTE FALLOS, DEBERÁ REEMPLAZARLO. •LENTE DE PRUEBA LIQUIDA MENCIONA QUE EN CASO DE PRESENTAR RUPTURA Y/O ALGÚN ERROR INCORREGIBLE CON CALIBRACIÓN DEBERÁ SUSTITUIR EL LENTE. •FILTRO DE AIRE MENCIONA QUE SE DEBERÁ SUSTITUIR EL FILTRO DE ENTRADA DE AIRE PARA REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. Y QUE LA ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SON TRABAJOS DE OBRA CIVIL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
25	ANEXO 1 PARTIDA UNICA ROUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO	EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, PORTATUBOS) EN CASO DE ENCONTRAR DESPERFECTO DEBERÁ	LOS EMPAQUES FILTROS DE AIRE Y CARBONES FORMAN PARTE DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO PREVENTIVO A ESTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	<p>EQUIPO: CENTRIFUGA</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>CORREGIRSE.</p> <p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> •PANEL DE CONTROL REVISAR QUE LA BOTONERA O EL PANEL DE CONTROL SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO VISUAL Y FUNCIONAL DE ACUERDO A LO ESPERADO EN CASO CONTRARIO CORREGIRLO Y/O REEMPLAZARLO. SE DEBERÁN SUSTITUIR LOS BOTONES SUMIDOS Y/O REALIZAR LIMPIEZA DE LOS MISMOS HASTA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. •PUERTA MENCIONA REVISIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SENSORES DE CIERRE Y APERTURA, EN CASO DE ENCONTRAR UN FALLO DEBERÁN SUSTITUIRSE LOS SENSORES. REVISIÓN DEL EMPAQUE EN CASO DE ENCONTRAR ROTURAS O CUARTEADURA DEBERÁ SUSTITUIRLO. •FILTRO DE AIRE MENCIONA QUE SE DEBERÁ SUSTITUIR EL FILTRO DE ENTRADA DE AIRE PARA REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO. •MOTOR REALIZAR VERIFICACIÓN DE CARBONES DE MOTOR DE ENCONTRARSE DESGASTADOS DEBERÁN REEMPLAZARSE POR UNOS NUEVOS. <p>CONSIDERAMOS QUE ESTE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</p>	<p>TIPO DE EQUIPOS POR LO QUE DEBERAN CONSIDERARSE COMO TAL DENTRO DE SU PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PARA EL RESTO DE LAS REFACCIONES DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>
--	---	--	--

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
26	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: COLPOSCOPIO</p> <p>ACCESORIOS. INSPECCIONAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO SEAN LAS ADECUADAS (TEMPERATURA HUMEDAD, VIBRACIONES ETC.) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, PORTATUBOS) EN CASO DE ENCONTRAR DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRSE.</p> <p>EN EL APARTADO DE INSPECCIONAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO SEAN LAS ADECUADAS (TEMPERATURA HUMEDAD, VIBRACIONES ETC.) MENCIONA EN CASO CONTRARIO CORREGIRLAS.</p> <p>PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA REVISAR QUE LA BOTONERA O EL PANEL DE CONTROL SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO VISUAL Y FUNCIONAL DE ACUERDO A LO ESPERADO EN CASO CONTRARIO CORREGIRLO Y/O REEMPLAZARLO. SE DEBERÁN SUSTITUIR LOS BOTONES SUMIDOS Y/O REALIZAR LIMPIEZA DE LOS MISMOS HASTA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. PERILLAS/SISTEMA MECÁNICO REALIZAR REVISIÓN DEL CARRO DE TRANSPORTE Y LOS BRAZOS DEL EQUIPO, LUBRICAR SUS PARTES MÓVILES Y REALIZAR SUSTITUCIÓN DE LLANTAS EN CASO DE REQUERIRLO. SISTEMA DE ILUMINACIÓN REEMPLAZAR LA LÁMPARA EN CASO DE SER NECESARIO. REALIZAR AJUSTE DE FIBRA ÓPTICA (SI APLICA) Y/O LÁMPARA Y CONECTORES. CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON</p>	<p>DADO EL CASO DE QUE SE DETECTEN CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS QUE PUEDAN COMPROMETER LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DEBERA ELABORAR UN REPORTE DE LAS MISMAS Y ENTREGARLO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASI COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y PARA EL RESTO DE LOS ACCESORIOS DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. Y QUE LA ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SON TRABAJOS DE OBRA CIVIL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
<p>27</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS (CABLE DE ALIMENTACIÓN, LATIGUILLOS DE ESTIMULACIÓN, ELECTRODOS REUSABLES ENTRE OTROS) EN CASO DE ENCONTRAR DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRSE. EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN.</p> <p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA •PANTALLA Y O BOTONERA DEL PANEL DE CONTROL, EN CASO DE DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRLO. PRUEBAS DE SALIDA EN CASO DE ENCONTRAR DESVIACIONES SUPERIORES DEBERÁ CORREGIRSE. VERIFICACIÓN FINAL. VERIFICACIÓN DE IMPRESIÓN / ENVIÓ DE DATOS CORRECTAMENTE Y DE ACUERDO A LO ENVIADO MEDIANTE EL SIMULADOR DE</p>	<p>LAS VERIFICACIONES DEBERAN SER REALIZADAS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO A LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO/ MANUAL DE FABRICANTE PARA EL CASO DE LAS DEMAS REFACCIONES DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>

Handwritten mark

Handwritten signatures and marks



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>PACIENTES (SI APLICA).</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
28	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR CON ULTRASONIDO (COMBO-ELECTRO)</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, LATIGUILLOS DE ESTIMULACIÓN, ELECTRODOS REUSABLES, TRANSDUCTOR, ENTRE OTROS) EN CASO DE ENCONTRAR DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRSE. EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN.</p> <p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA PANTALLA Y O BOTONERA DEL PANEL DE CONTROL, EN CASO DE DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRLO. PRUEBAS DE SALIDA ELECTROESTIMULADOR EN CASO DE ENCONTRAR DESVIACIONES SUPERIORES DEBERÁ CORREGIRSE. PRUEBAS DE SALIDA ULTRASONIDO VERIFICAR QUE NO EXISTAN CRISTALES DAÑADOS O MUERTOS EN CASO QUE LOS HAYA CORREGIR EL</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL</p>

cel

A
J
SA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>PROBLEMA. REEMPLAZO DE BATERÍA EN CUANTO A LAS BATERÍAS MENCIONA RETIRAR BATERÍA EN CASO DE SER NECESARIO Y REEMPLAZAR CON UNA BATERÍA ADECUADA EN CASO DE REQUERIR. SE SUGIERE REPORTAR. INSPECCIÓN DE COMPONENTES MENCIONA SUMINISTRO DE ACCESORIOS COMO CABLES DE RED Y/O FUSIBLES. CORREGIR EN CASO DE ENCONTRAR ANOMALÍAS.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
29	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: DE FLUOROANGIOGRAFIA</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, POSA BARBILLA) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN.</p> <p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA PANTALLA Y O BOTONERA DEL PANEL DE CONTROL, EN CASO DE DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRLO.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL</p>

Handwritten signatures and initials



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>ESTE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
30	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: FACOEMULSIFICADOR</p> <p>ACCESORIOS.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, OSCILADOR DE MICRO FRECUENCIA) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN. REEMPLAZO DE BATERÍA EN CUANTO A LAS BATERÍAS SE MENCIONA RETIRAR BATERÍA EN CASO DE SER NECESARIO Y REEMPLAZAR CON UNA BATERÍA ADECUADA EN CASO DE REQUERIR.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTE ES UN COMENTARIO</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD..</p>
<p>31</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA ROUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: LÁMPARA DE HENDIDURA</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, PALANCA DE MOVIMIENTO) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN.</p> <p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE DE ILUMINACIÓN, REALIZAR CAMBIO DE FOCO EN CASO DE SER NECESARIO.</p>	<p>EL CAMBIO DE LA FUENTE DE ILUMINACION FORMA PARTE INTEGRAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LO CUAL DEBERA CONSIDERARSE DENTRO DE SU PROPUESTA Y PARA LOS DEMAS ELEMENTOS DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>

37

W

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>CONSIDERAMOS QUE ESTE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
<p>32</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: LASER ARGÓN</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, PALANCA DE MOVIMIENTO) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN.</p> <p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA</p> <ul style="list-style-type: none"> •SISTEMA ÓPTICO REVISAR LOS OCULARES EN BUSCA DE DAÑOS RALLADURAS O DESPERFECTOS, CORREGIR AQUELLOS QUE SURJAN. VERIFICAR QUE EL RESTO DEL SISTEMA ÓPTICO NO PRESENTE ARTEFACTOS. EN CASO DE SER ASÍ DEBERÁ CORREGIRLOS. •SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE DE ILUMINACIÓN REALIZAR CAMBIO DE FOCO EN CASO DE SER NECESARIO. <p>CONSIDERAMOS QUE ESTE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN</p>	<p>EL CAMBIO DE LA FUENTE DE ILUMINACION FORMA PARTE INTEGRAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LO CUAL DEBERA CONSIDERARSE DENTRO DE SU PROPUESTA Y PARA LOS DEMAS ELEMENTOS DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>

09/

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
<p>33</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA.</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, PALANCA DE MOVIMIENTO) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN. REEMPLAZO DE BATERÍA VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERÍAS DE RESPALDO, SU ÚLTIMO CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO (CAMBIO MAYOR A 3 AÑOS) DEBERÁN REEMPLAZARSE.</p> <p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA</p> <ul style="list-style-type: none"> •TACÓMETRO ÓPTICO EN CASO DE ENCONTRAR DESPERFECTOS, DEBERÁ REALIZAR UN AJUSTE MECÁNICO QUE PERMITA CORREGIR LA FALLA EN LA MEDICIÓN DE LO CONTRARIO DEBERÁ SUSTITUIR EL TACÓMETRO ÓPTICO. •BOMBA REALIZAR PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL MOTOR, EN CASO DE QUE SEA MENOR A 75K DEBERÁ REEMPLAZARSE. EN CASO DE QUE LA BOMBA FUNCIONE A TRAVÉS DE CORREAS DEBERÁ VERIFICAR EL BUEN 	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES SE REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE</p>

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>ESTADO DE ESTAS (NO DESGASTADAS NO AGRIETADAS) EN CASO DE ENCONTRAR DESPERFECTO DEBERÁ SUSTITUIRLO. •SENSOR DE PRESIÓN VERIFICAR EL CORRECTO ESTADO DE LAS GALGAS EXTENSIOMETRICAS EN CASO DE ENCONTRAR DIFERENCIAS MAYORES EN CUALQUIERA DE ELLAS DEBERÁ REALIZAR EL CAMBIO DEL ARREGLO COMPLETO. SI NO ESTÁ FUNCIONAL EL SENSOR DE PRESIÓN SUSTITUIRLO. •DETECTOR DE BURBUJAS VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DETECTOR SI NO FUNCIONA DEBERÁ SUSTITUIRSE. •SENSOR DE NIVEL VERIFICAR EL SENSOR EN CASO DE QUE FALLE DEBERÁ REEMPLAZARLO.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
34	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA ROUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: MICROSCOPIO DE CIRUGÍA</p> <p>ACCESORIOS.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, PALANCA DE MOVIMIENTO) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN.</p>	<p>EL CAMBIO DE LA FUENTE DE ILUMINACION FORMA PARTE INTEGRAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LO CUAL DEBERA CONSIDERARSE DENTRO DE SU PROPUESTA Y PARA LOS DEMAS</p>

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	<p>PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA, •SISTEMA ÓPTICO VERIFICAR QUE EL RESTO DEL SISTEMA ÓPTICO NO PRESENTE ARTEFACTOS EN CASO DE SER ASÍ DEBERÁ CORREGIRLOS. REVISAR LOS OCULARES EN BUSCA DE DAÑOS COMO RALLADURAS O DESPERFECTOS, CORREGIR AQUELLOS QUE SURJAN. •SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE DE ILUMINACIÓN, REALIZAR CAMBIO DE FOCO EN CASO DE SER NECESARIO.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ELEMENTOS DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>
<p>35</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: MICRÓTOMO</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, PALANCA DE MOVIMIENTO) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN.</p> <p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA. •SISTEMA MÓVIL, REVISAR</p>	<p>EN LOS PRIMEROS PUNTOS SE PIDE CORREGIR CUESTIONES MECANICAS PROPIAS DEL EQUIPO ASI COMO LA FUENTE DE ILUMINACION.</p>

41

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>QUE EL SISTEMA DE BLOQUEO DE MANIVELAS FUNCIONE CORRECTAMENTE, EN CASO CONTRARIO CORREGIR LA FALLA.</p> <ul style="list-style-type: none"> •CUCHILLO VERIFICAR QUE EL PLANO DE MOVIMIENTO DEL CABEZAL DE LA CUCHILLA SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ CORREGIRLO. •SISTEMA ELÉCTRICO Y DE REFRIGERACIÓN (SI APLICA) VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE DE ILUMINACIÓN, REALIZAR CAMBIO DE FOCO EN CASO DE SER NECESARIO. <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</p> <p>ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
36	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: OXÍMETRO DE PULSO</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, SENSOR DE SPO2 ENTRE OTROS) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN.</p> <p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA SUSTITUIR EL SENSOR DE SPO2 POR</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES</p>

Handwritten signatures and initials



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>UNO NUEVO Y COMPATIBLE CON EL EQUIPO.</p> <p>LAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES NO ESTÁN CONSIDERADOS COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LO CUAL SE PODRÁN INCLUIR COMO PARTES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS; LOS CUALES SE COTIZARÁN POR APARTE.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES SE REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
37	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: PAQUIMETRO</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN.</p> <p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA</p> <ul style="list-style-type: none"> •PANTALLA Y CONTROLES VERIFICAR EL BUEN 	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICAS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR</p>

at

[Handwritten signatures and marks]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>ESTADO DE LA PANTALLA Y SUS CONTROLES ASOCIADOS, EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRLO.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</p> <p>ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES SE REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
38	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: PROCESADOR DE TEJIDO</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN, TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN.</p> <p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA •PANTALLA Y CONTROLES VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LA PANTALLA</p>	<p>EL CAMBIO DE FILTROS DE AIRE ASI COMO LA REVISION DE LOS ELEMNTOS MECANICOS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.Y PARA EL RESTO DE LAS REFACCIONES DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>

at

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>Y SUS CONTROLES ASOCIADOS, EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRLO.</p> <ul style="list-style-type: none"> •SONDA Y ELEMENTO TÉRMICO REALIZAR REVISIÓN DE LA CORRECTA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA, EN CASO DE EXISTIR ERROR DEBERÁ REEMPLAZARLO. •FILTRO DE AIRE REVISAR EL TIEMPO DE VIDA DEL FILTRO DE AIRE, EN CASO DE HABER EXCEDIDO O ESTAR POR LLEGAR AL TIEMPO DE VIDA ESTIPULADO POR EL MANUAL DEL FABRICANTE, DEBERÁ REEMPLAZARSE. •SISTEMA MECÁNICO EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRLO <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</p> <p>ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
39	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA ROUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: REFRACTOQUERATOMETRO</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN.</p> <p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA</p>	<p>LA SUSTITUCION DE LAS LAMPARAS DAÑADAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MANTINIEMIENTO PREVENTIVO Y PARA EL RESTO DE LOS SISTEMAS REFERIDOS DEBERA CONSIDERARSE DENTRO DE SU PROPUESTA Y PARA LOS DEMAS ELEMENTOS DEBERA CUMPLIR CON</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>•PANTALLA Y CONTROLES, VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA Y LA PALANCA DE CONTROL, ASÍ COMO EL SELECTOR(ES) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRSE.</p> <p>•SISTEMA ÓPTICO REVISAR EL SISTEMA ÓPTICO EN BUSCA DE ARTEFACTOS EN LA IMAGEN EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ARTEFACTO DEBERÁ CORREGIRLO.</p> <p>•SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LÁMPARAS Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EQUIPO. EN CASO DE ENCONTRAR LÁMPARAS DAÑADAS DEBERÁ SUSTITUIRLAS.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</p> <p>ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>
40	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: TERMÓMETRO DIGITAL</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN Y SONDA DE TEMPERATURA) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN.</p> <p>EN EL APARTADO DE</p>	<p>LOS AJUSTES Y CALIBRACIONES CON EQUIPO VALIDADO POR EL EMA FORMA PARTE INTEGRAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS Y PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS DEBERA CONSIDERARSE DENTRO DE SU PROPUESTA Y PARA LOS</p>

Handwritten mark

Handwritten signatures



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA •PANTALLA Y CONTROLES, VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA ASÍ COMO EL DEL SELECTOR(ES) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRSE. •SONDA DE TEMPERATURA EN CASO DE ENCONTRAR DISCREPANCIAS DEBERÁ SUSTITUIR LA SONDA DE TEMPERATURA Y/O REALIZAR LA CALIBRACIÓN DEL TERMÓMETRO.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>DEMÁS ELEMENTOS DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>
41	<p>ANEXO 1 PARTIDA ÚNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA</p> <p>ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE ACCESORIOS MENCIONA (CABLE DE ALIMENTACIÓN) EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN.</p> <p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA •PANTALLA Y CONTROLES, VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA Y LA PALANCA DE CONTROL, ASÍ COMO EL SELECTOR(ES) EN CASO DE ENCONTRAR</p>	<p>EL CAMBIO DE LA FUENTE DE ILUMINACIÓN ASÍ COMO EL AJUSTE MECÁNICO DE LAS PIEZAS QUE CONFORMAN EL EQUIPO CORRESPONDEN A UNA PARTE INTEGRAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PARA EL RESTO DE LAS REFACCIONES DEBERÁ CONSIDERARSE DENTRO DE SU PROPUESTA Y PARA LOS DEMÁS ELEMENTOS DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>ALGÚN DESPERFECTO DEBERÁ CORREGIRSE. •SISTEMA ÓPTICO REVISAR EL SISTEMA ÓPTICO EN BUSCA DE ARTEFACTOS EN LA IMAGEN EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ARTEFACTO DEBERÁ CORREGIRLO. •SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LÁMPARAS Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EQUIPO. EN CASO DE ENCONTRAR LÁMPARAS DAÑADAS DEBERÁ SUSTITUIRLAS.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>
<p>42</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA ROUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: ULTRASONIDO TERAPÉUTICO</p> <p>SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO. SISTEMA MECÁNICO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO MENCIONA: SE ESTABLECE VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LÁMPARAS Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EQUIPO, EN CASO DE ENCONTRAR LÁMPARAS DAÑADAS, DEBERÁ SUSTITUIRLAS", SUSTITUIR LAS LÁMPARAS DAÑADAS</p> <p>EN EL APARTADO DE SISTEMA MECÁNICO: SE MENCIONA LIMPIAR Y LUBRICAR LOS ELEMENTOS MECÁNICOS</p>	<p>EL CAMBIO DE LA FUENTE DE ILUMINACION ASI COMO EL AJUSTE MECANICO DE LAS PIEZAS QUE CONFORMAN EL EQUIPO CORRESPONDE A UNA PARTE INTEGRAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>DEL EQUIPO, ASÍ COMO TODAS SUS PARTES MÓVILES ASOCIADAS. EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN DESPERFECTO, DEBERÁ CORREGIRLO.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
43	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: UNIDAD OFTALMOLÓGICA</p> <p>PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SISTEMA ÓPTICO. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO. SISTEMA MECÁNICO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA (SILLÓN Y SISTEMA MECÁNICO); SE ESTABLECE REVISIÓN DE SISTEMA DE BRAZOS ARTICULADOS. DEBERÁ REALIZAR LA INSPECCIÓN DE MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS, EN CASO QUE LOS PISTONES NO MANTENGAN EN SUS SITO LOS BRAZOS, DEBERÁ REALIZAR EL CAMBIO</p> <p>EN EL APARTADO DE SISTEMA ÓPTICO MENCIONA REALIZAR REVISIÓN DE FORÓPTERO EN BUSCA DE ARTEFACTOS, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNO, SE DEBERÁ CORREGIR, EL TÉRMINO CORREGIR ES AMBIGUO.</p> <p>EN EL APARTADO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO: SE ESTABLECE VERIFICAR EL CORRECTO</p>	<p>EL CAMBIO DE LA FUENTE DE ILUMINACION ASI COMO EL AJUSTE MECANICO DE LAS PIEZAS QUE CONFORMAN EL EQUIPO CORRESPONDE A UNA PARTE INTEGRAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PARA EL RESTO DE LOS PUNTOS MENCIONADOS DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>FUNCIONAMIENTO DE LAS LÁMPARAS Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EQUIPO, EN CASO DE ENCONTRAR LÁMPARAS DAÑADAS, DEBERÁ SUSTITUIRLAS"</p> <p>EN EL APARTADO DE SISTEMA MECÁNICO: SE MENCIONA LIMPIAR Y LUBRICAR LOS ELEMENTOS MECÁNICOS DEL EQUIPO, ASÍ COMO TODAS SUS PARTES MÓVILES ASOCIADAS. EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN DESPERFECTO, DEBERÁ CORREGIRLO". CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
44	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: EVACUADOR DE HUMO</p> <p>INSPECCIÓN DE COMPONENTES.</p>	<p>EN EL APARTADO DE INSPECCIÓN DE COMPONENTES: SE MENCIONA VERIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES COMO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, ELECTRODOS REUSABLES Y PERIFÉRICOS EN BUSCA DE ANOMALÍAS COMO: QUEMADURAS, DEFORMACIONES, DESGASTE, ETC. EN CASO DE ENCONTRAR ANOMALÍAS, CORREGIRLAS SUMINISTRAR CABLE DE RED Y/O FUSIBLES EN CASO DE SER NECESARIO.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE</p>	<p>EL CAMBIO DE FUSIBLES LA CORRECCION DE QUEMADURAS O DESGASTE DE TARJETAS ELECTRONICAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PARA EL RESTO DE LAS REFACCIONES DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
<p>45</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: PISTOLA DE CRIOCIRUGÍA</p> <p>PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (GENERALES): SE ENUNCIA COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD. EN CASO DE DAÑO O MAL FUNCIONAMIENTO SE DEBERÁ CORREGIR O SUSTITUIR.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES SE REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A</p>

51

W

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

			<p>ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
<p>46</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: NEBULIZADOR</p> <p>INSPECCIÓN DE COMPONENTES.</p>	<p>EN EL APARTADO DE INSPECCIÓN DE COMPONENTES: SE MENCIONA VERIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES COMO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, ELECTRODOS REUSABLES Y PERIFÉRICOS EN BUSCA DE ANOMALÍAS COMO: QUEMADURAS, DEFORMACIONES, DESGASTE, ETC. EN CASO DE ENCONTRAR ANOMALÍAS, CORREGIRLAS SUMINISTRAR CABLE DE RED Y/O FUSIBLES EN CASO DE SER NECESARIO".</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN</p>	<p>EL CAMBIO DE FUSIBLES LA CORRECCION DE QUEMADURAS O DESGASTE DE TARJETAS ELECTRONICAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PARA EL RESTO DE LAS REFACCIONES DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
47	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: LÁMPARA QUIRÚRGICA</p> <p>VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. REEMPLAZO DE BATERÍA.</p>	<p>EN EL APARTADO DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MENCIONA: • VERIFICAR EL BUEN ESTADO Y/O FUNCIONAMIENTO DE BALASTRO, SOPORTE DE BULBO Y TERMOSTATO (EN CASO DE QUE APLIQUE). EN CASO DE EXISTIR UN ERROR EN ESTE, DEBERÁ CAMBIARSE POR UNO NUEVO EN BUEN ESTADO. • VERIFICAR EL BUEN ESTADO Y/O FUNCIONAMIENTO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, VENTILADOR, TABLERO INDICADOR, CORTACIRCUITOS, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, FILTRO DE LÍNEA, MEDIDOR DE HORAS. EN CASO DE ALGÚN DESPERFECTO, CORREGIRLO. • REALIZAR VERIFICACIÓN DE BRAZOS MECÁNICOS, EN CASO DE QUE NO CONSERVEN LA POSICIÓN DESEADA, DEBERÁ SUSTITUIR LOS PISTONES. • SISTEMA MECÁNICO: SE EXPRESA VERIFICAR EL SISTEMA DE RODAMIENTO (LÁMPARAS QUIRÚRGICAS DE EMERGENCIA), EN CASO DE DESPERFECTO EN ALGUNA DE SUS RUEDAS, DEBERÁ CORREGIRLO. EN EL APARTADO DE REEMPLAZO DE BATERÍA: SE ENUNCIA "RETIRAR LA BATERÍA, EN CASO DE SER NECESARIO, SEGÚN LO INDICADO EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO Y REEMPLAZAR CON UNA BATERÍA ADECUADA (SI APLICA).</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICAS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES SE REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE</p>

Cal

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ESTO REPRESENTA COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
<p>48</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: CONCENTRADOR DE OXÍGENO</p> <p>INSPECCIÓN DE COMPONENTES.</p>	<p>EN EL APARTADO DE INSPECCIÓN DE COMPONENTES: SE MENCIONA VERIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES COMO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, ELECTRODOS REUSABLES Y PERIFÉRICOS EN BUSCA DE ANOMALÍAS COMO: QUEMADURAS, DEFORMACIONES, DESGASTE, ETC. EN CASO DE ENCONTRAR ANOMALÍAS, CORREGIRLAS SUMINISTRAR CABLE DE RED Y/O FUSIBLES EN CASO DE SER NECESARIO.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO.</p>	<p>EL CAMBIO DE FUSIBLES LA CORRECCION DE QUEMADURAS O DESGASTE DE TARJETAS ELECTRONICAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PARA EL RESTO DE LAS REFACCIONES DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
49	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: EQUIPO DE EMISIONES OTOACÚSTICAS</p> <p>SISTEMA DE CARGA.</p>	<p>EN EL APARTADO DE SISTEMA DE CARGA: SE EXPRESA REALIZAR PRUEBA DE CARGA DE EQUIPOS Y VERIFICAR EL ESTADO DE LA BATERÍA, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE FUERA DE SU VIDA ÚTIL, DEBERÁ SUSTITUIRLA.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</p> <p>ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICAS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE</p>

SS

ca

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

50	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: ESPIRÓMETRO</p> <p>SISTEMA DE CARGA. INSPECCIÓN DE COMPONENTES.</p>	<p>EN EL APARTADO DE SISTEMA DE CARGA: SE EXPRESA VERIFICAR EL ESTADO DE LA BATERÍA, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE FUERA DE SU VIDA ÚTIL, DEBERÁ SUSTITUIRLA.</p> <p>EN EL APARTADO DE INSPECCIÓN DE COMPONENTES: SE MENCIONA VERIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES COMO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, ELECTRODOS REUSABLES Y PERIFÉRICOS EN BUSCA DE ANOMALÍAS COMO: QUEMADURAS, DEFORMACIONES, DESGASTE, ETC. EN CASO DE ENCONTRAR ANOMALÍAS, CORREGIRLAS SUMINISTRAR CABLE DE RED Y/O FUSIBLES EN CASO DE SER NECESARIO. CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>SALUD.</p> <p>EL CAMBIO DE FUSIBLES LA CORRECCION DE QUEMADURAS O DESGASTE DE TARJETAS ELECTRONICAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PARA EL RESTO DE LAS REFACCIONES DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>
51	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: MONITOR DE INTEGRIDAD NERVIOSA</p> <p>INSPECCIÓN GENERAL.</p>	<p>EN EL APARTADO DE INSPECCIÓN GENERAL: SE ESTABLECE ESTADO DE TESTIGOS. VERIFICAR QUE LOS TESTIGOS DE CORRIENTE AC, BATERÍA, CARGA, ENTRE OTROS, ESTÉN FUNCIONANDO Y SE ENCIENDAN EN EL MOMENTO ADECUADO. EN</p>	<p>LA VERIFICACION DE LOS TESTIGOS DEL EQUIPO ASI COMO EL ASEGURAMIENTO DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PARA EL RESTO DE LOS DEBERA</p>

~~56~~

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	REEMPLAZO DE BATERÍA.	<p>CASO CONTRARIO, CORREGIRLO.</p> <p>EN EL APARTADO DE REEMPLAZO DE BATERÍA: SE ENUNCIA RETIRAR LA BATERÍA, EN CASO DE SER NECESARIO, SEGÚN LO INDICADO EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO Y REEMPLAZAR CON UNA BATERÍA ADECUADA. CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</p> <p>ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>
52	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: POTENCIALES EVOCADOS</p> <p>REEMPLAZO DE BATERÍA.</p>	<p>EN EL APARTADO DE REEMPLAZO DE BATERÍA: SE ENUNCIA RETIRAR LA BATERÍA, EN CASO DE SER NECESARIO, SEGÚN LO INDICADO EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO Y REEMPLAZAR CON UNA BATERÍA ADECUADA.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</p> <p>ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICAS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
<p>53</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMEDICO</p> <p>EQUIPO: MESA QUIRÚRGICA</p> <p>INSPECCIÓN DE COMPONENTES.</p>	<p>EN EL APARTADO DE INSPECCIÓN DE COMPONENTES: SE ENUNCIA VERIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES COMO: BANCO DE CAPACITORES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, FUENTES DE LUZ, BOMBA Y PERIFÉRICOS EN BUSCA DE ANOMALÍAS COMO: QUEMADURAS, DEFORMACIONES, DESGASTE, ETC. EN CASO DE ENCONTRAR DAÑO, CORREGIRLOS"</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE</p>

58

24

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
54	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: APARATO DE ISQUEMIA</p> <p>INSPECCIÓN GENERAL.</p>	<p>EN EL APARTADO DE INSPECCIÓN GENERAL: SE ESTABLECE "ACCESORIOS (CABLE DE ALIMENTACIÓN, PERILLAS, MANGUERAS Y MANGUITO, ENTRE OTROS). VERIFICAR EL ESTADO DE TODOS LOS ACCESORIOS CON LOS QUE CUENTA EL EQUIPO. EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN DESPERFECTO, DEBERÁ CORREGIRSE. EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN ELEMENTO CON DESGASTE, DEBERÁ REALIZAR SU SUSTITUCIÓN". ESTADO DE LAS BATERÍAS DE RESPALDO: VERIFICAR EL CORRECTOR FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERÍAS DE RESPALDO, VERIFICAR SU ÚLTIMO CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO (CAMBIO MAYOR A 3 AÑOS), DEBERÁN REEMPLAZARSE. BOMBA/INSUFLADOR: SE</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE</p>

01



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		<p>ENUNCIA "REALIZAR PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL MOTOR, EN CASO DE QUE SE MENOR A 75KΩ, DEBERÁ REEMPLAZARSE. EN CASO DE ENCONTRAR EL MANGUITO DESGASTADO O CON FUGAS, DEBERÁ SUSTITUIRLO. SENSOR DE PRESIÓN: "CON AYUDA DE UN SIMULADOR PARA CALIBRACIÓN DE PRESIÓN DEBERÁ REALIZA UN BARRIDO DE PRESIÓN COMENZADO DESDE 0MMHG HASTA 300 MMHG (O EL LÍMITE DE PRESIÓN ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE EN EL MANUAL DE SERVICIO), VERIFICANDO QUE EL VALOR SIMULADO SEA EL VALOR MOSTRADO POR EL SENSOR DE PRESIÓN. EN CASO CONTRARIO, DEBERÁ SUSTITUIRLO.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTA COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>
55	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: ULTRASONIDO OFTÁLMICO</p>	<p>EN EL APARTADO DE INSPECCIÓN GENERAL: SE ESTABLECE "ESTADO DE TESTIGOS. VERIFICAR QUE LOS TESTIGOS DE CORRIENTE AC, BATERÍA, CARGA, ENTRE OTROS, ESTÉN FUNCIONANDO Y SE ENCIENDAN EN EL</p>	<p>ESTOS PUNTOS SON PARTE INTEGRAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DEBERAN SER CONSIDERADOS COMO TAL.</p>

60

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	<p>INSPECCIÓN GENERAL. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO.</p>	<p>MOMENTO ADECUADO. EN CASO CONTRARIO, CORREGIRLO. EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (PANTALLA Y CONTROLES): SE EXPRESA VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LA PANTALLA Y LA PALANCA O RUEDA DE CONTROL, ASÍ COMO EL SELECTOR(ES). EN CASO DE ENCONTRAR ALGÚN DESPERFECTO, DEBERÁ CORREGIRLO. EN EL APARTADO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO: SE ESTABLECE "VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LÁMPARAS Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EQUIPO, EN CASO DE ENCONTRAR LÁMPARAS DAÑADAS, DEBERÁ SUSTITUIRLAS.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	
<p>56</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA ROUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ELECTROMÉDICO</p> <p>EQUIPO: MONITOR HEMODYNÁMICO</p> <p>INSPECCIÓN GENERAL. REEMPLAZO DE BATERÍA.</p>	<p>EN EL APARTADO DE INSPECCIÓN GENERAL: SE ESTABLECE "ESTADO DE TESTIGOS. VERIFICAR QUE LOS TESTIGOS DE CORRIENTE AC, BATERÍA, CARGA, ENTRE OTROS, ESTÉN FUNCIONANDO Y SE ENCIENDAN EN EL MOMENTO ADECUADO. EN CASO CONTRARIO,</p>	<p>PARA EL CASO DE LA BATERIA DEBERA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 1 Y 2 DEL APARTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PARA LOS OTROS PUNTOS MENCIONADOS SON PARTE INTEGRAL DEL</p>

61

del

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. SSSLP-LP-N5-2023

	<p>INSPECCIÓN DE COMPONENTES.</p>	<p>CORREGIRLO.</p> <p>EN EL APARTADO DE REEMPLAZO DE BATERÍA: SE ENUNCIA "RETIRAR LA BATERÍA, EN CASO DE SER NECESARIO, SEGÚN LO INDICADO EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL EQUIPO Y REEMPLAZAR CON UNA BATERÍA ADECUADA.</p> <p>EN EL APARTADO DE INSPECCIÓN DE COMPONENTES: SE MENCIONA "VERIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES COMO: TARJETAS ELECTRÓNICAS, ELECTRODOS REUSABLES Y PERIFÉRICOS EN BUSCA DE ANOMALÍAS COMO: QUEMADURAS, DEFORMACIONES, DESGASTE, ETC. EN CASO DE ENCONTRAR ANOMALÍAS, CORREGIRLAS SUMINISTRAR CABLE DE RED Y/O FUSIBLES EN CASO DE SER NECESARIO.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ESTOS SON COMENTARIOS AMBIGUOS YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</p> <p>ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DEBERAN TRATARSE COMO TAL.</p>
<p>57</p>	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMAGENOLOGIA</p> <p>EQUIPO: RAYOS X</p>	<p>EN EL APARTADO DE TRANSFORMADOR: SE ESTABLECE "PRUEBA DIELECTRICA DE ACEITE, CAMBIO O RECARGA EN CASO DE SER NECESARIO", ESTA</p>	<p>PUEDE OMITIR EL PASO DE LA PRUEBA DIELECTRICA DEL ACEITE SIN EMBARGO LA REVISION DE IMPEDENCIAS DEBE SER REALIZADA TODA VEZ</p>

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

	<p>CONVENCIONAL</p> <p>TRANSFORMADOR. CABLE DE ALTA TENSIÓN.</p>	<p>ACTIVIDAD IMPLICA RETIRAR LOS SELLOS DEL EQUIPO, AL HACER PUEDE INGRESAR HUMEDAD AL SISTEMA.</p> <p>EN EL APARTADO DE CABLE DE ALTA TENSIÓN MENCIONA: "REVISIÓN DE IMPEDANCIAS" ACTIVIDAD FUERA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO.</p> <p>TODA VEZ QUE ESTAS ACTIVIDADES YA ESTÁN FUERA DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS ACTUALES, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE QUE SE ELIMINEN DE LA LISTA DE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA ESTOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>QUE DE ELLO DEPENDE QUE SE MANTENGA UNA CORRECTA RELACION SEÑAL RUIDO</p>
58	<p>ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMAGENOLOGIA</p> <p>EQUIPO: DOPPLER</p> <p>VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.</p>	<p>EN EL APARTADO DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: SE ESTABLECE REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS ANALÓGICO-DIGITAL DAÑADAS, CAMBIO DE PERILLAS DE CONTROLES DAÑADAS.</p> <p>CONSIDERAMOS QUE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</p> <p>ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO,</p>

63

04

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. SSSLP-LP-N5-2023

			DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.
59	ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMAGENOLOGIA EQUIPO: TOMÓGRAFO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.	EN EL APARTADO DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: SE MENCIONA "REVISIÓN Y AJUSTE DE CABLE DE LÍNEA REEMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO". CONSIDERAMOS QUE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. SSSLP-LP-N5-2023

			LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTE COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.
60	ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMAGENOLOGIA EQUIPO: RAYOS X CON FLUOROSCOPIA TRANSFORMADOR.	EN EL APARTADO TRANSFORMADOR: SE ESTABLECE "PRUEBA DIELÉCTRICA DE ACEITE, CAMBIO O RECARGA EN CASO DE SER NECESARIO", ESTA ACTIVIDAD IMPLICA RETIRAR LOS SELLOS DEL EQUIPO, AL HACER PUEDE INGRESAR HUMEDAD AL SISTEMA. TODA VEZ QUE ESTA ACTIVIDAD YA ESTÁ FUERA DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS ACTUALES, SE SOLICITA RESPECTUOSAMENTE QUE SE ELIMINE DE LA LISTA DE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA ESTOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?	.PUEDE OMITIR EL PASO DE LA PRUEBA DIELECTRICA DEL ACEITE SIN EMBARGO LA REVISION DE IMPEDENCIAS DEBE SER REALIZADA TODA VEZ QUE DE ELLO DEPENDE QUE SE MANTENGA UNA CORRECTA RELACION SEÑAL RUIDO
61	ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMAGENOLOGIA EQUIPO: MASTÓGRAFO TRANSFORMADOR.	EN EL APARTADO DE TRANSFORMADOR: SE ESTABLECE "PRUEBA DIELÉCTRICA DE ACEITE", ESTA ACTIVIDAD IMPLICA RETIRAR LOS SELLOS DEL EQUIPO, AL HACER PUEDE INGRESAR HUMEDAD AL SISTEMA. TODA VEZ QUE ESTA ACTIVIDAD YA ESTÁ FUERA DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS	PUEDE OMITIR EL PASO DE LA PRUEBA DIELECTRICA DEL ACEITE SIN EMBARGO LA REVISION DE IMPEDENCIAS DEBE SER REALIZADA TODA VEZ QUE DE ELLO DEPENDE QUE SE MANTENGA UNA CORRECTA RELACION SEÑAL RUIDO

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

		ACTUALES, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE QUE SE ELIMINE DEL LISTA DE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA ESTOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA?	
62	ANEXO 1 PARTIDA UNICA RUTINAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA EQUIPO: DIGITALIZADOR DE IMAGEN DIGITALIZADOR.	EN EL APARTADO DIGITALIZADOR: SE MENCIONA "REVISAR LÁMPARAS DE DIGITALIZACIÓN, EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA FUNDIDA DEBERÁ REEMPLAZARSE". CONSIDERAMOS QUE ES UN COMENTARIO AMBIGUO YA QUE IMPLICA CAMBIO DE PIEZAS, EN CUYO CASO SE SUGIERE SE REPORTE Y SE ATIENDAN COMO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ENTENDEMOS QUE NO SE CORREGIRÁ Y SE REPORTARÁ YA QUE SE TRATA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO CORRECTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO NÚMERO 1 Y 2 DEL APARTADO "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO" DE LA SECCIÓN "TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉCNICOS" DE LAS BASES PARA ESTA CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON REFACCIONES INCLUIDAS HASTA POR UN 40% DEL VALOR UNITARIO DEL EQUIPO Y/O MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LOS CUALES S REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÚNICAMENTE SE CONTEMPLAN LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A REQUERIR, YA QUE LA MANO DE OBRA ASOCIADA A ESTE YA SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE QUE EN EL LISTADO DE EQUIPOS A ATENDER EN EL APARTADO "TIPO DE SERVICIO" SE ESPECIFICA QUE SE DEBEN PRESTAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGUNA ANOMALÍA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE PUEDA SER CORREGIDA SIN NECESIDAD DE RECURRIR A CAMBIO DE PIEZAS O REFACCIONES, EL PROVEEDOR



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. SSSLP-LP-N5-2023

			ADJUDICADO DEBERÁ REALIZARLO SIN QUE ESTO REPRESENTA COSTO ADICIONAL PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.
--	--	--	---

LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE LAS ACLARACIONES QUE CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE LICITACION. **SE CITA EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2023 A LAS 12:00 HORAS PARA LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA ASI COMO LA APERTURA TÉCNICA.**

LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO A SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, FIRMÁNDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN A CONTINUACIÓN. DÁNDOSE POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA SIENDO LAS **15:40 HORAS DEL DÍA 12 DE MAYO DEL 2023.**

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE ACTO SE LES HACE ENTREGA DE UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA CON ACUSE DE RECIBO A LOS LICITANTES ASISTENTES, ASIMISMO, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARÁ EN: EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD UBICADO EN PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE NO. 5850, LOMAS DE LA VIRGEN, CP 78380, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA O UN AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.

ESTA ACTA CONSTA DE **68** HOJAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
MEDSOLUTIONS S.A DE C.V.	ALEJANDRO MENDOZA KLEN	
VIACOMER S DE R.L DE C.V	LUIS ALBERTO TOVAR ACOSTA	
MAWA INTEGRAL S.A DE C.V	SAMANTHA QUETZALI GOMEZ ALONSO	

07

al

fe



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. SSSLP-LP-N5-2023

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
ING. CARLOS FEDERICO CARRANZA BENÍTEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
C.P CELENE MORENO JUAREZ	POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	
LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	POR LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	
ING. ANA LUISA ALVAREZ LOPEZ	AREA TECNICA	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
C.P CARLOS ISIDRO SALAS COMPEAN	

----- FIN DEL ACTA -----

ANEXO 1



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SS

SERVICIOS DE SALUD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

RECIBO PROVISIONAL

FECHA: 08 DE MAYO DE 2023

CONCEPTO: PAGO DE BASES DEL PROCESO DE LICITACIÓN: SSSLP-LP-N5-2023
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ÁREAS DE INGENIERÍA CLÍNICA Y
DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN"

PROVEEDOR: MAWA INTEGRAL

RFC: MIN2205093S2

MONTO: \$3,000.00



SERVICIOS DE SALUD
DE SAN LUIS POTOSI
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Jay Carlos Francisco Carranza Bruiroz
NOMBRE SELLO Y FIRMA

[Handwritten signatures and initials]



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2023

SS

SERVICIOS DE SALUD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

RECIBO PROVISIONAL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2023

CONCEPTO: PAGO DE BASES DEL PROCESO DE LICITACIÓN: SSSLP-LP-N5-2023
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ÁREAS DE INGENIERÍA CLÍNICA Y
DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN"

PROVEEDOR: VIACOMER, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: VIA090831F49

MONTO: \$3,000.00



SERVICIOS DE SALUD
 DE SAN LUIS POTOSÍ
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NOMBRE SELLO Y FIRMA

Jay. CARLOS FROBACU CARRANZA BÉNITEZ

[Handwritten signatures and initials]



POTOSÍ
 PARA LOS POTOSINOS
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SS

SERVICIOS DE SALUD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

RECIBO PROVISIONAL

FECHA: 08 DE MAYO DE 2023

**CONCEPTO: PAGO DE BASES DEL PROCESO DE LICITACIÓN: SSSLP-LP-N5-2023
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ÁREAS DE INGENIERÍA CLÍNICA Y
DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN"**

PROVEEDOR: **MEDSOLUTIONS**


RFC: **MED080911CD3**

MONTO: **\$3,000.00**



SERVICIOS DE SALUD
 DE SAN LUIS POTOSÍ
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Iny *Carlos Frohman* *Benitez*
 NOMBRE SELLO Y FIRMA

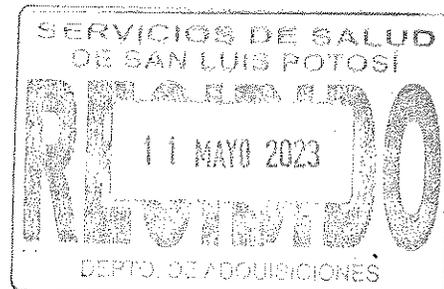

Recibí preguntas en formato
 adaracion de dudas. *FEAL*